
MEDICAL ASEM

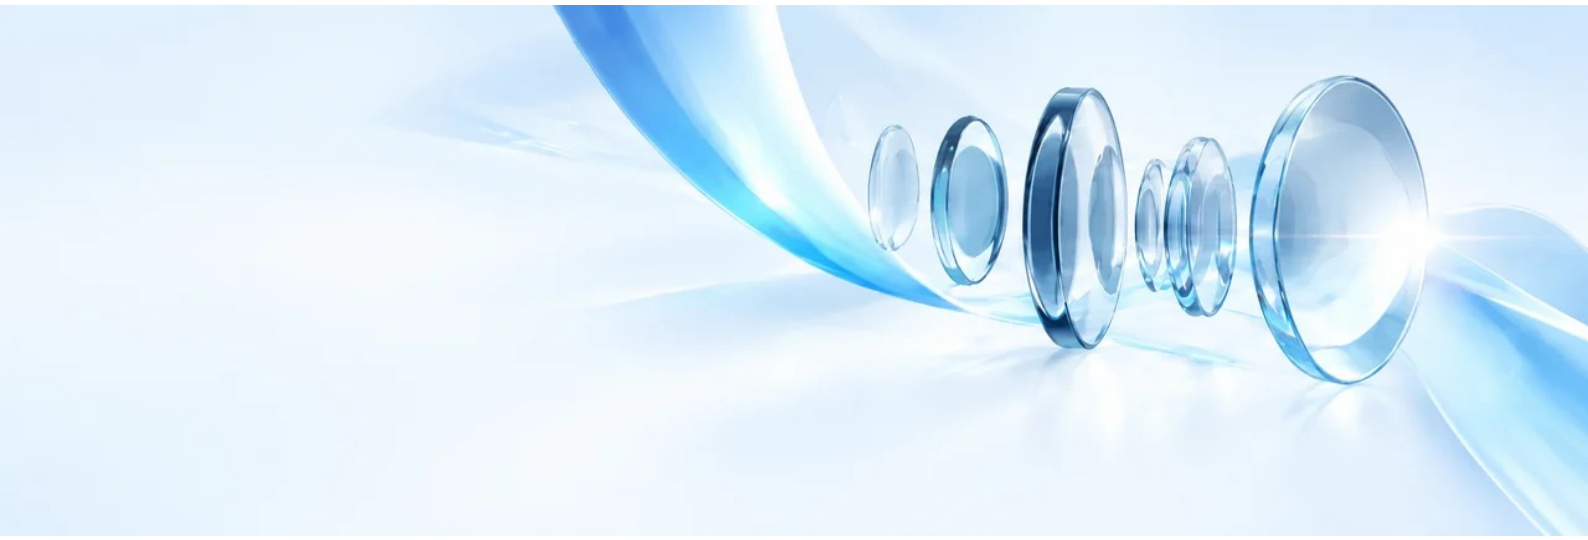

كتالوج أجهزة طب العيون

63 جهازًا

تشكيلة ASEM العامة من الأجهزة. يجب تأكيد المواصفات والتجهيزات المتاحة لدى الشركة المصنّعة. لا يحلّ هذا الكتالوج محل وثائق الشركة المصنّعة.

أُنشئ في 2026-11-10

Huvitz | ASEM

OCTavius



خمس فحوصات في منصة واحدة للتصوير العيني.

معلومات متحقّق منها

تصوير متعدد الوسائط

.والطبوغرافيا الحيوية والقياسات والأوعية الشبكية وتصوير OCT

· 2026-10-05 huvitz.com

التقاط OCT سريع

.80,000 مسح A في الثانية لالتقاط OCT

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

HBM-1



قياسات حيوية بصرية وطبوغرافيا القرنية للتقييم قبل الجراحة.

معلومات متحقّق منها

قياسات حيوية بصرية

قياس الطول المحوري من 14 إلى 40 mm.

· 2026-10-05 www.huvitz.com

طبوغرافيا بلاسيدو

24 حلقة لرسم خريطة سطح القرنية.

· 2026-10-05 www.huvitz.com

حساب عدسة IOL

حساب IOL وتحليل زيرنيكه مدمجان.

· 2026-10-05 www.huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-9000A



قياس الانكسار وتقييم سطح العين في جهاز واحد.

معلومات متحقّق منها

قياس انكسار آلي

الكرة من −30 إلى +25 D؛ والأسطوانة حتى 12 D.

· 2026-10-05 huvitz.com

سطح العين

تصوير غدد ميبوميوس وتحليل زمن تفكك الدمع.

· 2026-10-05 huvitz.com

قياس تحدب محيطي

قياس تقوس القرنية المركزي والمحيطي.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Eyestar 900



قياسات حيوية بصرية وتحدب القرنية في نظام يستخدم EyeSuite.

معلومات متحقّق منها

قياسات OCT بمصدر ممسوح

قياسات OCT بمصدر ممسوح من القرنية إلى الشبكية.

· 2026-10-17 haag-streit.com

خرائط القرنية

أدوات الطبوغرافيا والسماكة لتقييم القرنية.

· 2026-10-17 haag-streit.com

التقاط آلي للبيانات

التقاط آلي مصمّم لقياس العينين.

· 2026-10-17 haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Elara 900



مصباح شقي بمجهر غاليليو وخمس درجات تكبير.

معلومات متحقّق منها

إضاءة شقية إسقاطية

إضاءة إسقاطية لمشاهدة بنى العين.

· 2026-10-17 us.haag-streit.com

تقييم الغدد بالأشعة تحت الحمراء

إضاءة تحت الحمراء لتقييم غدد ميبوميوس.

· 2026-10-17 us.haag-streit.com

تحكم آلي بالفحص

تحكم بمحركات في ارتفاع الجهاز والتكبير.

· 2026-10-17 us.haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · us.haag-streit.com

Easyvisus RM64 — 3 أجهزة



وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

معلومات متحقّق منها

محطة لـ3 أجهزة

سطح طاولة منظّم لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

· 2026-10-17 www.fiso.info

تموضع كهربائي

ضبط سطح الطاولة والكرسي كهربائيًا.

· 2026-10-17 www.fiso.info

قفل كهرومغناطيسي

قفل سطح الطاولة وذراع الفوروبتر.

· 2026-10-17 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® Plus



تقنية البلازما مع 3 مقابض لمستويات شدة مختلفة.

معلومات متحقّق منها

تقنية البلازما

إيصال الطاقة عبر قوس بلازما مركّز.

· 2026-10-17 gruppogmv.com

3 مقابض

ثلاثة مقابض: أبيض وأخضر وأحمر.

· 2026-10-17 gruppogmv.com

تطبيق دون تلامس

إيصال الطاقة دون ملامسة مباشرة للجلد.

· 2026-10-17 gruppogmv.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · gruppogmv.com

R-Evo Smart® CR



استحلاب العدسة واستئصال الجسم الزجاجي الأمامي والخلفي.

معلومات متحقّق منها

جراحة مشتركة

استحلاب العدسة واستئصال الزجاجي الأمامي والخلفي.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

نظام شفط مزدوج

الاختيار بين مضخَتَي التمعّج وفنتوري.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

استحلاب بالموجات فوق الصوتية

بث مستمر أو نبضي أو متقطّع بتردد نحو 40 kHz.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.bvimedical.com

Haag-Streit | ASEM

METIS 900



مجهر جراحي عيني بتكبير وضبط بؤري رأسي يعملان بمحركات.

معلومات متحقّق منها

منعكس أحمر متحد المحور

إضاءة المنعكس الأحمر المتحدة المحور للرؤية الجراحية.

· 2026-10-17 us.haag-streit.com

ميل الرؤية بمحرك

إمالة بمحرك لضبط زاوية الرؤية الجراحية.

· 2026-10-17 us.haag-streit.com

تحكم يدوي وقدمي

تشغيل التكبير والبؤرة باليد أو القدم.

حسب التجهيز

· 2026-10-17 us.haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · us.haag-streit.com

Easyvisus MS33 — 3 أجهزة



وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

معلومات متحقّق منها

محطة لـ3 أجهزة

سطح طاولة منظّم لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

· 2026-10-17 www.fiso.info

تموضع كهربائي

ضبط سطح الطاولة والكرسي كهربائيًا.

· 2026-10-17 www.fiso.info

قفل كهرومغناطيسي

قفل سطح الطاولة وذراع الفوروبتر.

· 2026-10-17 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

Easyvisus Curve



وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

معلومات متحقّق منها

محطة لـ2 جهاز

سطح طاولة منظّم لاستيعاب جهازَي فحص (2).

· 2026-10-17 www.fiso.info

اختيار سطح الطاولة

إصدار دوّار أو منزلق لجهازين.

حسب التجهيز

· 2026-10-17 www.fiso.info

قفل كهرومغناطيسي

قفل سطح الطاولة وذراع الفوروبتر.

· 2026-10-17 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

Plexr® PRO



تقنية البلازما مع 2 مقبض لمستويات شدة مختلفة.

معلومات متحقّق منها

تقنية البلازما

إيصال الطاقة عبر قوس بلازما مركّز.

· 2026-10-17 gruppogmv.com

2 مقبض

مقبضان: One P وTwo P.

· 2026-10-17 gruppogmv.com

تطبيق دون تلامس

إيصال الطاقة دون ملامسة مباشرة للجلد.

· 2026-10-17 gruppogmv.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · gruppogmv.com

PIROP A+B+CCT



قياسات حيوية وتصوير بالموجات فوق الصوتية وسماكة القرنية في جهاز واحد.

معلومات متحقّق منها

قياسات حيوية بنمط A

الطول المحوري وحساب قوة العدسة داخل العين.

· 2026-10-17 echoson.pl

تصوير بنمط B

تصوير بنى مقلة العين بالموجات فوق الصوتية.

· 2026-10-17 echoson.pl

قياس سماكة CCT

قياس سماكة القرنية بالموجات فوق الصوتية.

· 2026-10-17 echoson.pl

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · echoson.pl

HTR-1A



الانكسار والقرنية وضغط العين في منصة متكاملة.

معلومات متحقّق منها

الانكسار وتحدب القرنية

قياسان لفحص الانكسار في جهاز واحد.

· 2026-10-05 huvitz.com

قياس ضغط دون تلامس

قياس ضغط العين دون تلامس.

· 2026-10-05 huvitz.com

قياس سماكة القرنية

قياس سماكة القرنية في الجهاز نفسه.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

HOCT-1 / HOCT-1F



.واحدة منصة في الحدقة توسيع دون العين قاع وتصوير طيفي OCT

معلومات متحقّق منها

تصوير OCT طيفي

دقة محورية تبلغ 7 µm لتصوير OCT.

huvitz.com · 2026-10-05

تصوير قاع العين المدمج

تصوير قاع العين دون توسيع الحدقة.

فقط HOCT-1F

huvitz.com · 2026-10-05

إدارة الصور

إدارة الفحوصات ببرنامج HIIS-1.

huvitz.com · 2026-10-05

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

HFC-1



تصوير قاع العين دون توسيع الحدقة مع التقاط بانورامي.

معلومات متحقّق منها

تصوير دون توسيع الحدقة

التقاط صور الشبكية بمجال 45°.

· 2026-10-05 www.huvitz.com

عرض بانورامي

دمج صور قاع العين في صورة بانورامية.

· 2026-10-05 www.huvitz.com

حدقة صغيرة

التقاط الصور بدءًا من قطر حدقة 3.3 mm.

· 2026-10-05 www.huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HDR-9000



فوروبتر رقمي للفحص الذاتي ونقل القياسات.

معلومات متحقّق منها

قياس انكسار ذاتي

الكرة من −29 إلى +26.75 D للفحص البصري.

· 2026-10-05 huvitz.com

تصحيح منشوري

قوة منشورية حتى 20 Δ.

· 2026-10-05 huvitz.com

اتصال لاسلكي

تبادل البيانات عبر Wi-Fi أو RS-232.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

HVS-1



تحرّي الانكسار في العينين عن بُعد.

معلومات متحقّق منها

تحرّ ثنائي العينين

قياس انكسار العينين عن بُعد.

· 2026-10-05 huvitz.com

نطاق الانكسار

الكرة من −8 إلى +8 D؛ والأسطوانة حتى 3 D.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Huvitz | ASEM

HS-7500



بصريات غاليليو وخمس درجات تكبير للفحص بالمصباح الشقي.

معلومات متحقّق منها

خمس درجات تكبير

6× و10× و16× و25× و40× لتكييف رؤية الفحص.

· 2026-10-04 huvitz.com

شق الفحص

فتحة شق تصل إلى 14 × 14 mm.

· 2026-10-04 huvitz.com

مرشحات المشاهدة

مرشحا الأزرق الكوبالتي والأخضر للفحص.

· 2026-10-04 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

HRK-8100A



قياس انكسار آلي مع قياس تحدب القرنية المركزي والمحيطي.

معلومات متحقّق منها

قياس انكسار آلي

الكرة من −30 إلى +25 D؛ والأسطوانة حتى 12 D.

· 2026-10-05 huvitz.com

محيط القرنية

قياس تحدب القرنية المركزي والمحيطي في فحص واحد.

· 2026-10-05 huvitz.com

تقوس العدسات

قياس تقوس العدسات اللاصقة.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lenstar 900



جهاز قياسات حيوية بصري مع قياس تحدب القرنية وبرنامج EyeSuite.

معلومات متحقّق منها

قياسات حيوية بصرية OLCR

قياسات محورية للعين لدعم التخطيط لعدسة IOL.

· 2026-10-17 haag-streit.com

قياسات قرنية ثنائية المنطقة

قياس تحدب بمنطقتين لتقييم تقوس القرنية.

· 2026-10-17 haag-streit.com

تخطيط IOL ببرنامج EyeSuite

حساب عدسة IOL واختيارها ضمن IOL EyeSuite.

حسب إعداد البرنامج

· 2026-10-17 haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Refractor 900



فوروبتر لقياس الانكسار الذاتي مع الاتصال بالأجهزة.

معلومات متحقّق منها

قياس انكسار ذاتي

ضبط العدسات لفحوصات الانكسار الذاتي.

· 2026-10-17 haag-streit.com

تحكم بالفحص باللمس

إدارة الفحص عبر لوحة تعمل باللمس.

· 2026-10-17 haag-streit.com

تبادل البيانات السريرية

تبادل البيانات مع أجهزة التشخيص وسجلات المرضى.

تأكيد توافق النظام

· 2026-10-17 haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · haag-streit.com

Octopus 900



قياس مجال ثابت؛ والقدرات الأخرى تعتمد على التجهيز.

معلومات متحقّق منها

قياس ثابت لكامل المجال

اختبارات ثابتة للمجالين المركزي والمحيطي.

· 2026-10-17 haag-streit.com

فحص المجال الحركي

فحص حركي حسب الإصدار والترخيص.

الخيار حسب الإصدار

· 2026-10-17 haag-streit.com

تحليل التطور العام

تحليل التطور العام لسلسلة فحوصات المجال البصري.

· 2026-10-17 haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · haag-streit.com

Octopus 600



جهاز يجمع قياس المجال الثابت SAP وقياس المجال بتقنية Pulsar.

معلومات متحقّق منها

قياس ثابت مركزي

اختبارات المجال البصري المركزي بمنبهات أبيض على أبيض.

· 2026-10-17 haag-streit.com

تحليل التطور العام

مراجعة الفحوصات المتتالية وتطورها العام.

· 2026-10-17 haag-streit.com

دون غرفة مظلمة

يمكن إجراء الفحوصات خارج غرفة مظلمة.

· 2026-10-17 haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · haag-streit.com

BQ 900



مصباح شقي بمجهر غاليليو وخمس درجات تكبير وإضاءة LED.

معلومات متحقّق منها

بصريات مجهر غاليليو

خمس درجات تكبير من 6.3× إلى 40×.

· 2026-10-17 haag-streit.com

إضاءة شقية LED

إضاءة LED للمشاهدة بالمصباح الشقي.

إصدار LED

· 2026-10-17 de.haag-streit.com

خيارات تصوير المصباح الشقي

التقاط الصور بوحدة IM 600 أو IM 910.

وحدة تصوير اختيارية

· 2026-10-17 haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.haag-streit.com

BI 900



مصباح شقي بمجهر كبلر ودرجتَي تكبير وإضاءة LED.

معلومات متحقّق منها

بصريات مجهر كبلر

درجتا تكبير 10× و16× للفحص بالمصباح الشقي.

· 2026-10-17 us.haag-streit.com

مرشح تباين مدمج

مرشح مدمج لتعزيز التباين في الفحص الروتيني.

· 2026-10-17 us.haag-streit.com

خيارات تصوير المصباح الشقي

توثيق الفحوصات باستخدام Set Imaging 900 BI.

طقم تصوير اختياري

· 2026-10-17 us.haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.haag-streit.com

Imaging Module 910



وحدة تصوير لمصباح شقي متوافقة؛ يُؤكّد التجهيز مع ASEM.

معلومات متحقّق منها

التقاط صور بمساعدة

يساعد ضبط التعريض وفتحة العدسة الآلي في التقاط الصور.

يلزم مصباح شقي متوافق

· 2026-10-17 haag-streit.com

تحكم بالكاميرا في المتناول

عناصر تحكم بالكاميرا والإضاءة بجوار عصا التحكم.

· 2026-10-17 haag-streit.com

نمطا تكامل

تشغيل مستقل أو تكامل ضمن EyeSuite.

· 2026-10-17 haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · haag-streit.com

Easyvisus RM64 — جهازان



وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

معلومات متحقّق منها

محطة لـ2 جهاز

سطح طاولة منظّم لاستيعاب جهازَي فحص (2).

· 2026-10-17 www.fiso.info

تموضع كهربائي

ضبط سطح الطاولة والكرسي كهربائيًا.

· 2026-10-17 www.fiso.info

قفل كهرومغناطيسي

قفل سطح الطاولة وذراع الفوروبتر.

· 2026-10-17 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

Easyvisus RM64 Compact — 3 أجهزة



وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

معلومات متحقّق منها

محطة لـ3 أجهزة

سطح طاولة منظّم لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

· 2026-10-17 www.fiso.info

إتاحة الكرسي المتحرك

سطح طاولة يُفتح للفحص على كرسي متحرك.

· 2026-10-17 www.fiso.info

كرسي بضبط كهربائي

كرسي PRIMA بضبط كهربائي للارتفاع.

· 2026-10-17 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

جهازان — Easyvisus RM64 Compact



وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

معلومات متحقّق منها

محطة لـ2 جهاز

سطح طاولة منظّم لاستيعاب جهازَي فحص (2).

· 2026-10-17 www.fiso.info

إتاحة الكرسي المتحرك

سطح طاولة يُفتح للفحص على كرسي متحرك.

· 2026-10-17 www.fiso.info

كرسي بضبط كهربائي

كرسي PRIMA بضبط كهربائي للارتفاع.

· 2026-10-17 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

جهازان — Easyvisus MS33



وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

معلومات متحقّق منها

محطة لـ2 جهاز

سطح طاولة منظّم لاستيعاب جهازَي فحص (2).

· 2026-10-17 www.fiso.info

تموضع كهربائي

ضبط سطح الطاولة والكرسي كهربائيًا.

· 2026-10-17 www.fiso.info

قفل كهرومغناطيسي

قفل سطح الطاولة وذراع الفوروبتر.

· 2026-10-17 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

Easyvisus One



وحدة انكسار منظّمة لجهاز فحص واحد (1).

معلومات متحقّق منها

محطة لـ1 جهاز

سطح طاولة منظّم لجهاز فحص واحد (1).

· 2026-10-17 www.fiso.info

سطح بارتفاع ثابت

ذراع بقفل ميكانيكي في جميع الوضعيات.

· 2026-10-17 www.fiso.info

كرسي بضبط كهربائي

كرسي PRIMA بضبط كهربائي للارتفاع.

· 2026-10-17 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

Easyvisus Two



وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

معلومات متحقّق منها

محطة لـ2 جهاز

سطح طاولة منظّم لاستيعاب جهازَي فحص (2).

· 2026-10-17 www.fiso.info

توسيط الجهاز

سطح طاولة على شكل V بآلية لتوسيط الجهاز.

· 2026-10-17 www.fiso.info

كرسي بضبط كهربائي

كرسي PRIMA بضبط كهربائي للارتفاع.

· 2026-10-17 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

Panvisus Trio



وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

معلومات متحقّق منها

محطة لـ3 أجهزة

سطح طاولة منظّم لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

· 2026-10-17 www.fiso.info

تموضع كهربائي

ضبط سطح الطاولة والكرسي كهربائيًا.

· 2026-10-17 www.fiso.info

قفل كهرومغناطيسي

قفل سطح الطاولة وذراع الفوروبتر.

· 2026-10-17 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

R-Evo Smart® S



استحلاب العدسة واستئصال الجسم الزجاجي الأمامي.

معلومات متحقّق منها

القطعة الأمامية

استحلاب العدسة واستئصال الجسم الزجاجي الأمامي.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

نظام شفط مزدوج

الاختيار بين مضخَتَي التمعّج وفنتوري.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

استحلاب بالموجات فوق الصوتية

بث مستمر أو نبضي أو متقطّع بتردد نحو 40 kHz.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.bvimedical.com

R-Evo Smart® E



استحلاب العدسة واستئصال الجسم الزجاجي الأمامي.

معلومات متحقّق منها

القطعة الأمامية

استحلاب العدسة واستئصال الجسم الزجاجي الأمامي.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

شفط تمعّجي

شفط بواسطة مضخة تمعّجية.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

استحلاب بالموجات فوق الصوتية

بث مستمر أو نبضي أو متقطّع بتردد نحو 40 kHz.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.bvimedical.com

R-Evolution CR



استحلاب العدسة واستئصال الجسم الزجاجي الأمامي والخلفي.

معلومات متحقّق منها

جراحة مشتركة

استحلاب العدسة واستئصال الزجاجي الأمامي والخلفي.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

نظام شفط مزدوج

الاختيار بين مضخَتَي التمعّج وفنتوري.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

استحلاب بالموجات فوق الصوتية

بث مستمر أو نبضي أو متقطّع بتردد نحو 40 kHz.

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.bvimedical.com

R-Evolution



منصة لاستحلاب العدسة بوظائف جراحية قابلة للتهيئة.

معلومات متحقّق منها

إدارة السوائل

اختيار الشفط المعتمد على التدفق أو التفريغ.

حسب التجهيز

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

بث الموجات فوق الصوتية

أنماط نبضية ومتقطّعة لاستحلاب العدسة.

حسب التجهيز

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

إضاءة جراحية

ثلاثة مخارج LED مستقلة مع مرشحات لونية.

حسب التجهيز

· 2026-10-17 www.bvimedical.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.bvimedical.com

Table Hercule



تواصل مع ASEM للحصول على معلومات موثّقة حول هذا الطراز.

المواصفات التقنية بحاجة إلى تأكيد.

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

Trial Lenses set with Metal Rim in Beech Wood Case



236 عدسة تجريبية لفحص الانكسار الذاتي في حقيبة خشبية.

معلومات متحقّق منها

قياس انكسار ذاتي

مجموعة عدسات تجريبية لتركيب التصحيح البصري.

· 2026-10-05 www.fiso.info

236 عدسة تجريبية

مجموعة من 236 عدسة في حقيبة خشبية.

· 2026-10-05 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

51-B – 236 B Ensembles de lentilles d'essai



236 عدسة تجريبية لفحص الانكسار الذاتي في حقيبة ABS.

معلومات متحقّق منها

قياس انكسار ذاتي

مجموعة عدسات تجريبية لتركيب التصحيح البصري.

· 2026-10-05 www.fiso.info

236 عدسة تجريبية

مجموعة من 236 عدسة في حقيبة ABS.

· 2026-10-05 www.fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

lit chirurgical 77FY



كرسي عمليات مفصلي لجراحة اليوم الواحد.

معلومات متحقّق منها

تموضع جراحي

ضبط مسند الظهر ومسند الساقين والميل.

· 2026-10-05 www.frastema.com

تنقّل وكبح

عجلات قابلة للتوجيه مع كبح بالقدم.

· 2026-10-05 www.frastema.com

تغذية كهربائية مرنة

إصدار على الكهرباء أو بطارية 24 V حسب التجهيز.

حسب التجهيز

· 2026-10-05 www.frastema.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

92-FA



مقعد بعجلات قابل لضبط الارتفاع لمحطة الفحص.

معلومات متحقّق منها

ضبط هوائي للارتفاع

يمكن ضبط ارتفاع المقعد من 52 إلى 72 cm بآلية هوائية.

مقعد FISO FA-92. يجب تأكيد التنجيد والتجهيز عند التسليم.

· 2026-10-18 fiso.info

مقعد دائري مبطّن

مقعد دائري مبطّن بقطر 33 cm.

· 2026-10-18 fiso.info

قاعدة بخمسة أذرع

قاعدة مطلية بالكروم بمقاس 50 cm ومزوّدة بعجلات.

· 2026-10-18 fiso.info

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · fiso.info

Panvisus Rondo



وحدة Rondo Panvisus لجهازين، حسب التجهيز.

معلومات متحقّق منها

جهازان في وحدة واحدة

سطح طاولة لجهازين ضمن مجموعة Rondo.

خصائص مشتركة ضمن مجموعة Rondo Panvisus. يجب تأكيد مرجع سطح الطاولة وضبط الارتفاع والملحقات.

www.fiso.info · 2026-10-18

اختيار سطح الطاولة

سطح طاولة بشكل V أو منزلق، حسب المرجع.

www.fiso.info · 2026-10-18

الارتفاع حسب المرجع

سطح طاولة ثابت الارتفاع أو قابل للضبط كهربائيًا، حسب الإصدار.

www.fiso.info · 2026-10-18

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

Huvitz | ASEM

Réfracteur HDR-7100P



فوروبتر لفحص الانكسار الذاتي للبعيد والقريب.

معلومات متحقّق منها

قياس انكسار ذاتي

الكرة من −29 إلى +26.75 D للفحص البصري.

· 2026-10-05 huvitz.com

الرؤية القريبة

مسافة عمل قابلة للضبط من 35 إلى 70 cm.

· 2026-10-05 huvitz.com

تصحيح منشوري

قوة منشورية حتى 20 Δ.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lampe à fente BM-900



مصباح شقي بمجهر كبلر ودرجتَي تكبير 10× و16×.

معلومات متحقّق منها

بصريات مجهر كبلر

درجتا تكبير 10× و16× للفحص بالمصباح الشقي.

· 2026-10-17 haag-streit.com

إضاءة شقية LED

إضاءة LED للمشاهدة بالمصباح الشقي.

إصدار LED

· 2026-10-17 jp.haag-streit.com

تموضع الجهاز بيد واحدة

ذراع بيد واحدة لتموضع الجهاز على ثلاثة محاور.

· 2026-10-17 jp.haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · haag-streit.com

Frontofocometre Digital



قياس عدسات النظارات والعدسات اللاصقة بتقنية هارتمان.

معلومات متحقّق منها

تحليل هارتمان

قياس القوة الكروية والأسطوانية والمنشورية.

· 2026-10-05 huvitz.com

عدسات لاصقة

قياس العدسات اللاصقة الصلبة واللينة.

· 2026-10-05 huvitz.com

نطاق بصري واسع

الكرة من −25 إلى +25 D؛ والأسطوانة حتى 10 D.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

HIIS-1 (HIS-1)



برنامج لعرض الفحوص القادمة من أجهزة متوافقة.

معلومات متحقّق منها

عرض فحص واحد

عرض فحص واحد للاطلاع على بياناته.

يستخدم الكتيب الاسمين 1-HIS وHIIS-1. يجب تأكيد الإصدار والتراخيص والوحدات والأجهزة المتصلة.

optomedical.eu · 2026-10-18

عرض ستة فحوص

عرض يجمع ستة فحوص للاطلاع على نتائجها معًا.

optomedical.eu · 2026-10-18

تبادل بيانات DICOM

بروتوكول DICOM لتبادل البيانات مع أنظمة متوافقة.

optomedical.eu · 2026-10-18

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · optomedical.eu

Haag-Streit | ASEM

AT 900



مقياس توتر العين بالتسطيح وفق مبدأ Goldmann ضمن مجموعة AT 900.

معلومات متحقّق منها

مبدأ Goldmann

قياس ضغط العين بطريقة التسطيح.

خصائص مشتركة ضمن مجموعة AT 900. يجب تأكيد نوع التثبيت R أو T أو BQ والتوافق مع المصباح الشقي.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

نطاق القياس

نطاق ضغط موثق من 0 إلى 80 mmHg.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

التثبيت يحتاج إلى تأكيد

يجب تأكيد التثبيت R أو T أو BQ والتوافق.

uk.haag-streit.com · 2026-10-18

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · uk.haag-streit.com

Auto-réfkeratomètre HRK-1



قياس الانكسار وتحدب القرنية والمساعدة في ملاءمة العدسات اللاصقة.

معلومات متحقّق منها

الانكسار والقرنية

قياس الانكسار وتحدب القرنية في جهاز واحد.

· 2026-10-05 huvitz.com

ملاءمة العدسات اللاصقة

المساعدة في ملاءمة العدسات اللاصقة.

· 2026-10-05 huvitz.com

تتبع رأسي

تتبع التموضع الرأسي على مدى ±15 mm.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.huvitz.com

Frontofocometre HLM-7000P



قياس عدسات النظارات والعدسات اللاصقة.

معلومات متحقّق منها

قياس عدسات النظارات

قياس القوة الكروية والأسطوانية والمنشورية.

· 2026-10-05 huvitz.com

عدسات لاصقة

قياس العدسات اللاصقة الصلبة واللينة.

· 2026-10-05 huvitz.com

نطاق بصري واسع

الكرة من −25 إلى +25 D؛ والأسطوانة حتى 10 D.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Projecteur de test HCP-7000



جهاز عرض LED للاختبارات البصرية في العيادة.

معلومات متحقّق منها

اختبارات بصرية متنوعة

41 رمزًا بصريًا و34 قناع عرض.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض بتقنية LED

مصدر ضوء LED لعرض لوحات فحص النظر.

· 2026-10-05 huvitz.com

مسافة الفحص

عرض ملائم لمسافات فحص تتراوح بين 2.5–8 m.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Ecran Numérique HDC-9100N/PF



عرض رقمي للاختبارات البصرية على شاشة LCD بدقة HD Full.

معلومات متحقّق منها

اختبارات بدقة HD Full

شاشة LCD قياس 24 بوصة بدقة 1920 × 1080.

· 2026-10-05 huvitz.com

مسافة الفحص

عرض الاختبارات البصرية على مسافات حتى 6 m.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Champ visuel HVF-100



تقييم المجال البصري بقياس ثابت أبيض على أبيض.

معلومات متحقّق منها

قياس مجال ثابت

فحص المجال البصري أبيض على أبيض.

· 2026-10-05 huvitz.com

مجال حتى 90°

فحص محيط المجال البصري حتى 90°.

· 2026-10-05 huvitz.com

منبه III Goldmann

حجم منبه III Goldmann لاختبارات المجال البصري.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Tonomètre à air HNT-1/1P



قياس ضغط العين دون تلامس.

معلومات متحقّق منها

قياس ضغط دون تلامس

قياس ضغط العين دون تلامس.

· 2026-10-05 huvitz.com

نطاق الضغط

قياس الضغط ضمن نطاق 0–60 mmHg.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Topographe Optique Cornéen Complet



طبوغرافيا القرنية مع قياس تحدبها وتحليل زيرنيكه.

معلومات متحقّق منها

خرائط القرنية

رسم خريطة طبوغرافية لسطح القرنية.

· 2026-10-05 huvitz.com

تحليل زيرنيكه

تحليل زيغ القرنية باستخدام حدود زيرنيكه.

· 2026-10-05 huvitz.com

قياس تحدب مدمج

قياس تقوس القرنية ضمن الفحص نفسه.

· 2026-10-05 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · huvitz.com

Unité 2 postes



تواصل مع ASEM للحصول على معلومات موثّقة حول هذا الطراز.

المواصفات التقنية بحاجة إلى تأكيد.

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.fiso.info

EIBOS 2



ملحق لرؤية قاع العين بزاوية واسعة لمجهر جراحي متوافق.

معلومات متحقّق منها

رؤية واسعة دون تلامس

رؤية قاع العين بزاوية واسعة عبر مجهر جراحي.

يلزم مجهر متوافق

· 2026-10-17 haag-streit.com

عاكس صور مدمج

الضبط البؤري وعاكس الصور مدمجان في نظام واحد.

· 2026-10-17 haag-streit.com

ضبط بؤري يدوي

أذرع جانبية لضبط البؤرة يدويًا.

· 2026-10-17 haag-streit.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · haag-streit.com

مصباح شقي — Huvitz HS-7000



مصباح شقي ببصريات غاليليو وخمس درجات تكبير.

معلومات متحقّق منها

خمس درجات تكبير

6× و10× و16× و25× و40× لتكييف رؤية الفحص.

· 2026-10-06 huvitz.com

شق الفحص

فتحة شق تصل إلى 14 × 14 mm.

· 2026-10-06 huvitz.com

مرشحات المشاهدة

مرشحا الأزرق الكوبالتي والأخضر للفحص.

· 2026-10-06 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.huvitz.com

مصباح شقي — Huvitz HS-5000



مصباح شقي بإضاءة برجية وبصريات غاليليو.

معلومات متحقّق منها

خمس درجات تكبير

5,6× و11× و16× و23,2× و39,3× لتكييف رؤية الفحص.

· 2026-10-06 huvitz.com

شق الفحص

فتحة شق تصل إلى 14 × 14 mm.

· 2026-10-06 huvitz.com

إضاءة برجية

ميل الإضاءة بدرجات من 0° إلى 20°.

· 2026-10-06 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.huvitz.com

Huvitz HS-5500 — مصباح شقي



إضاءة مدمجة وبصريات غاليليو للمصباح الشقي.

معلومات متحقّق منها

خمس درجات تكبير

5,6× و11× و16× و23,2× و39,3× لتكييف رؤية الفحص.

· 2026-10-06 huvitz.com

شق الفحص

فتحة شق تصل إلى 14 × 14 mm.

· 2026-10-06 huvitz.com

إضاءة مدمجة

ميل مستمر للإضاءة من 0° إلى 20°.

· 2026-10-06 huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.huvitz.com

Huvitz HDC-7000 — نظام اختبارات بصرية



اختبارات بصرية رقمية للانكسار والرؤية الثنائية.

معلومات متحقّق منها

رؤية ثنائية العينين

اختبارات الرؤية المجسمة والدمج وتفاوت التثبيت.

· 2026-10-06 www.huvitz.com

اختبارات قابلة للتخصيص

تباين وأقنعة وأحمر/أخضر وعرض معكوس.

· 2026-10-06 www.huvitz.com

تثبيت على PC

اختبارات على PC وشاشة متوافقين يُحددان لاحقًا.

منفصلان وشاشة PC

· 2026-10-06 www.huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.huvitz.com

Huvitz CIT-4000 — طاولة مزودة بمحرك



طاولة بمحرك لتموضع أجهزة الفحص.

معلومات متحقّق منها

ضبط بمحرك

ضبط ارتفاع الجهاز كهربائيًا.

· 2026-10-06 www.huvitz.com

تنقّل داخل العيادة

عجلات لنقل الطاولة بين محطات الفحص.

· 2026-10-06 www.huvitz.com

تحكم قابل للتكييف

تحكم يدوي أو قدمي حسب الإصدار.

حسب التجهيز

· 2026-10-06 www.huvitz.com

عرض التفاصيل

الاطلاع على مصدر الشركة المصنّعة · www.huvitz.com