وحدات فحص الانكسار

Easyvisus MS33 — 3 أجهزة

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

Easyvisus MS33 لثلاثة أجهزة وحدة انكسار بطاولة دوارة يدويًا وكهربائية الارتفاع. تتحكم لوحة LCD وعصا التحكم في الحركات الرأسية للطاولة والكرسي وفي القفل. يكمل كرسي PRIMA الكهربائي وإضاءة LED والقاعدة ذات الأقدام القابلة للضبط التجهيز القياسي الموثق. ولا يُعلن تموضع آلي للطاولة في MS33 هذه.



Easyvisus MS33 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 09-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

محطة لـ3 أجهزة

سطح طاولة منظّم لاستيعاب 3 أجهزة فحص.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

تموضع كهربائي

ضبط سطح الطاولة والكرسي كهربائيًا.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

قفل كهرومغناطيسي

قفل سطح الطاولة وذراع الفوروبتر.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

تنظيم محطة Easyvisus MS33 — لـ3 أجهزة

تُظهر صورة الشركة المصنعة التجهيز الدقيق للمحطة والوصول إلى الأجهزة.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026


تحديد موضع سطح العمل

تسهّل حركة سطح العمل الموثقة الانتقال بين الأجهزة في Easyvisus MS33 — لـ3 أجهزة.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

التخطيط للتركيب

يوضح الرسم الرسمي الحيز المطلوب ويساعد على التحضير لتركيب Easyvisus MS33 — لـ3 أجهزة.

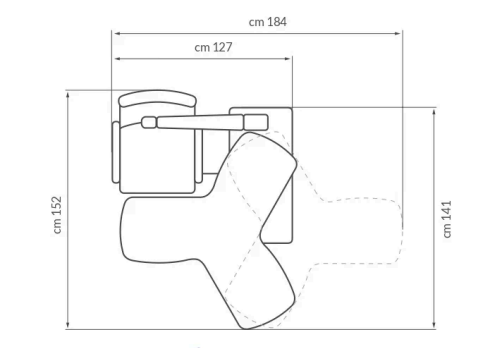

Easyvisus MS33 · مخطط التركيب

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

راحة الاستخدام

توزيع ضُمم حول محطة الاستشارة.

أجهزة منظمة

تجد التجهيزات مكانها في وحدة مخصصة.

ضبط المحطة

تسهّل الحركات المتاحة تكييف التجهيز.

الإمكانات في الممارسة

وحدة فحص الانكسار

المصادر والوثائق

مسار عمل أكثر سلاسة

طاولة للأجهزة المختارة

يتضمن المرجع القياسي 400300 طاولة بدوران يدوي لثلاثة أجهزة وارتفاع كهربائي. لا يصف جدول الشركة المصنعة نسخة بتموضع آلي. ولا تعني سعة ثلاثة مواضع شمول ثلاثة أجهزة؛ بل يجب تحديد الأجهزة ودعاماتها في تجهيز ASEM.

المصادر والوثائق

التحكم والتموضع الموثقان

تتيح لوحة LCD تخصيص الشعار. تتحكم عصا التحكم في رفع الكرسي والطاولة وخفضهما وفي القفل. توثق الشركة المصنعة قفلاً كهرومغناطيسيًا للطاولة الدوارة وذراعها. ويختلف التشغيل الكهربائي للارتفاع عن نمط الدوران أو الانزلاق المحدد للمرجع.

المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

كرسي قياسي وملحقات اختيارية

يتميز PRIMA القياسي بارتفاع كهربائي وكسوة سكاي سوداء دون مسند قدم. ومسند القدم القابل للرفع والكسوات الأخرى والاستبدال بطراز كرسي مختلف خيارات موثقة. يجب تأكيد نسخة الكرسي في عرض سعر ASEM. قد تظهر الصور الأصلية مسند قدم أو ذراع فورويتر أو ملحقات اختيارية أخرى، ولا تثبت رؤيتها أنها مشمولة. يجب تحديد الأجهزة والملحقات كل على حدة.

المصادر والوثائق

الإضاءة وتغذية الأجهزة

يتضمن العمود الألومنيومي إضاءة LED محيطة قابلة للضبط ومصباح قراءة LED ولوحة لحمل عارض الاختبارات. تحتوي الوحدة الرئيسية على تغذية محول المصباح الشقي، وللقاعدة الفولاذية المطلية أقدام قابلة للضبط. تندرج مصادر تغذية الأجهزة الإضافية ضمن الملحقات ولا تُعد مشمولة تلقائيًا. ولا يُستنتج جهد أو تردد دخل للوحدة الكاملة.

المصادر والوثائق



Easyvisus MS33 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق



Easyvisus MS33 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

التركيب واختيار التجهيز

نسخة اليد اليسرى 400300S اختيارية. يخص الرسم ذو الأبعاد المرجع 400300 ويحدد ارتفاع العمود خصوصًا؛ ولا يُستخدم هذا البعد كارتفاع إجمالي للوحدة أو مدى حركة للطاولة. لا توفر الصفحات وزنًا أو تردد تغذية أو نطاقًا رقميًا للارتفاع. يجب تأكيد توزيع العيادة والملحقات والأجهزة مع ASEM.

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

العلامة التجارية
.F.I.S.O

الطراز
3 — Easyvisus MS33 أجهزة

التقنية
وحدة قياس الانكسار

الاستخدام السريري
تقنيات متخصصة

عدد الأجهزة التي يستوعبها
3

المصادر والوثائق

ارتفاع الكرسي
ضبط كهربائي؛ كرسي Prima قياسي

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

ارتفاع سطح العمل
ضبط كهربائي

المصادر والوثائق

قفل سطح العمل
الطاولة والذراع: قفل كهرومغناطيسي

المصادر والوثائق

حركة سطح العمل
دوران يدوي؛ تموضع آلي حسب المرجع

اختيار تجهيز المصنّع؛ لا يُفترض تلقائياً أن أي خيار مثبّت.

المصادر والوثائق

إضاءة محطة العمل

إضاءة محيطة LED · إضاءة قراءة LED

المصادر والوثائق

أدوات التحكم

لوحة LCD؛ عصا تحكم للضبط والقفل

المصادر والوثائق


القاعدة

فولاذ مطلي؛ أقدام قابلة للضبط

المصادر والوثائق

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

اختيار تجهيز المصنّع؛ لا يُفترض تلقائياً أن أي خيار مثبّت.

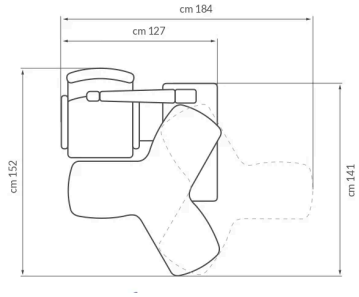

Easyvisus MS33 · مخطط التركيب

المصادر والوثائق

التنزيلات والموارد

وثائق الشركة المصنعة

PDF · 15,672 kB

المصادر والوثائق

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  تم التحقق من المصدر في 05-10-2026
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  تم التحقق من المصدر في 06-10-2026
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-3-instruments_450/
  تم التحقق من المصدر في 30-08-2026
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول 3 — Easyvisus MS33 أجهزة

ما المواصفة «عدد الأجهزة التي يستوعبها» الموثقة لجهاز 3 — Easyvisus MS33 أجهزة؟

3

المصادر والوثائق

ما المواصفة «ارتفاع الكرسي» الموثقة لجهاز 3 — Easyvisus MS33 أجهزة؟

ضبط كهربائي؛ كرسي Prima قياسي — لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

ما التجهيز الذي ينبغي تأكيده لجهاز 3 — Easyvisus MS33 أجهزة؟

لا يُفترض تركيب مساند القدمين والكراسي الاختيارية الأخرى.

المصادر والوثائق

أين أجد وثائق 3 — Easyvisus MS33 أجهزة؟

وثائق الشركة المصنعة (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

المصادر والوثائق

هل يملك MS33 لثلاثة أجهزة دورانًا تلقائيًا؟

تتميز التهيئة الموثقة 400300 بدوران يدوي وضبط كهربائي للارتفاع. ولا يجوز إسناد التموضع التلقائي الخاص بنماذج RM64 إليها.

المصادر والوثائق

هل يوجد إصدار للأعسر؟

تحدد النشرة 400300S باعتباره بديلًا اختياريًا للأعسر. وينبغي تحديد الكرسي وترتيب الاستخدام في العرض.

المصادر والوثائق

ما الكرسي الموصوف في التهيئة القياسية؟

يوصف كرسي PRIMA بضبط كهربائي للارتفاع وكسوة سوداء ومن دون مسند للقدمين. أما مسند القدمين والنماذج الأخرى فهي ملحقات أو بدائل.

المصادر والوثائق

منتجات ذات صلة



Panvisus Rondo

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة Panvisus Rondo لجهازين، حسب التجهيز.

عرض المنتج



Easyvisus Curve

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

عرض المنتج



جهازان — Easyvisus MS33

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لاستيعاب جهازَي فحص (2).

عرض المنتج



Easyvisus One

.F.I.S.O

وحدات فحص الانكسار

وحدة انكسار منظّمة لجهاز فحص واحد (1).

عرض المنتج

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطبابات هذا الجهاز.

التقنيات المتخصصة

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد




رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: bbdfd06a084a