المصابيح الشقية

BQ 900

مصباح شقي بمجهر غاليليو وخمس درجات تكبير وإضاءة LED.



BQ 900 · صورة الجهاز

المصادر والوثائق

طلب عرض سعر

عرض المنتج

تم الإنشاء في 09-11-2026

أعدّت ASEM هذه النشرة. وهي لا تحل محل الوثائق الرسمية للشركة المصنعة أو تعليمات الاستخدام الخاصة بها.

أبرز المزايا

بصريات مجهر غاليليو

خمس درجات تكبير من 6.3× إلى 40×.

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

إضاءة شقية LED

إضاءة LED للمشاهدة بالمصباح الشقي.

إصدار LED

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

خيارات تصوير المصباح الشقي

التقاط الصور بوحدة IM 600 أو IM 910.

وحدة تصوير اختيارية

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 17-10-2026

ملاحظة التفاصيل

تدعم منظومة BQ 900 البصرية الملاحظة التفصيلية للقطعة الأمامية.




BQ 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

ضبط دقيق

تُبقي أدوات التحكم وعصا التحكم الإعدادات المفيدة في متناول اليد.

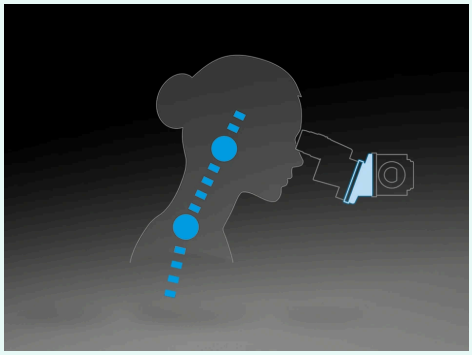

BQ 900 · رسم توضيحي من المصنّع


صورة توضيحية من المصنّع: قد تختلف التهيئة المعروضة عن التهيئة المسلَّمة.

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

إضافة التصوير

يستوعب التجهيز الموثق وحدات تصوير Haag-Streit لحفظ الملاحظات.

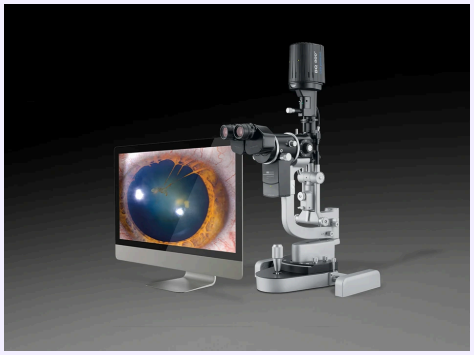

BQ 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق · تم التحقق من المصدر في 30-08-2026

ملاحظة سريرية

نظام بصري مخصص للفحص بالمصباح الشقي.

إضاءة مضبوطة

اضبط الملاحظة حسب احتياجات الفحص.

راحة الممارس

تجهيز صُمم للعمل اليومي.

الإمكانات في الممارسة

الملاحظة بخمسة مستويات تكبير

يوفر المجهر الغاليلي مستويات 6.3× و10× و16× و25× و40×. ويتيح التبديل المتدرج الانتقال من النظرة العامة إلى التفاصيل.



BQ 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

الجمع بين المجهر والإضاءة

يجمع النظام مجهرًا مجسمًا وإضاءة شقية قابلة للتوجيه. وتدعم إعدادات الشق والمرشحات ملاحظة الأنسجة العينية.

المصادر والوثائق

BQ 900: مرجع لأطباء العيون

توفر BQ 900 إضاءة LED متقدمة وشقًا بعرض 0-14 mm وطول 1-14 mm ومجال إضاءة 0.2 إلى 8 mm. يتيح المجهر تكبيرًا من 6.3× إلى 40×، وعدسة عينية 12.5× قابلة للضبط من +8 إلى –8 ديوبتر، وزاوية تجسيم 13° للفحص الدقيق والمريح.

تحكم ثلاثي الأبعاد سلس وضبط مكاني دقيق ضمن تصميم مدمج 332×305×700 mm، لدعم احتياجات طبيب العيون.

محول عدسة عينية مائل

يوفر محول العدسة العينية المائل وضعية رؤية مريحة بزاوية مضبوطة عند 20 درجة، لتحسين الوضعية والحد من إجهاد العنق ودعم العمل دون تعب.

بصريات مائلة

فحوص مريحة دون تعب، حتى خلال أيام العمل الطويلة.

ضمان 10 سنوات

تقدم خدمات Haag-Streit دعمًا عالميًا بمساندة محلية، مع الصيانة والإصلاح وطلب القطع للحد من الأعطال ووقت التوقف وإطالة عمر التجهيزات. يتلقى مهندسو الخدمة تدريبًا منتظمًا لدعم أجهزة التشخيص والجراحة والمحاكاة وبرمجية EyeSuite. وتدعم الشبكة العالمية خدمة مستمرة تساعد الممارسين على رعاية المرضى.

مسار عمل أكثر سلاسة

إضافة توثيق الصور

تعرض الشركة IM600 وIM910 كحلول تصوير مرتبطة بـBQ900. ويتوقف توفرها ووظائفها على الوحدة المثبتة.

وحدة التصوير اختيارية؛ ولا يُفترض تضمين ترخيص ثلاثي الأبعاد.



BQ 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

التخطيط لقياس الضغط المتوافق

يمكن إضافة مقياس ضغط Goldmann AT900 متوافق إلى المصباح. ويجب مطابقة النسخة والتثبيت مع التجهيز المختار.

يجب تحديد الملحق بصورة منفصلة؛ ولا يُساوى بمرجع الكتالوج79 غير المحدد.


المصادر والوثائق

مصمم للممارسة اليومية

تكييف وضعية الملاحظة

يتوفر محول للعدسات العينية المائلة كخيار. ويغير زاوية الملاحظة دون أن يضيف وظيفة تصوير إلى المصباح.

محول اختياري.

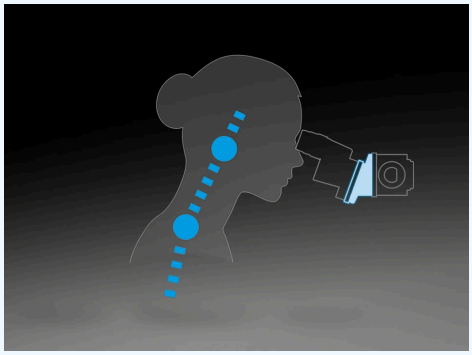

BQ 900 · رسم توضيحي من المصنّع

صورة توضيحية من المصنّع: قد تختلف التهيئة المعروضة عن التهيئة المسلَّمة.

المصادر والوثائق

المصادر والوثائق

المواصفات الفنية والوثائق

العلامة التجارية
Haag-Streit

الطراز
BQ 900

التقنية
مصباح شقي

الاستخدام السريري
التشخيص والقياسات الحيوية

درجات التكبير
×6.3 · ×10 · ×16 · ×25 · ×40

التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

عدد درجات التكبير
5

التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

عرض الشق
14 mm

المصادر والوثائق

طول الشق
14 mm

المصادر والوثائق

بصريات المجهر
غاليلي

المصادر والوثائق

المرشحات
أزرق · أخضر خالٍ من الأحمر · رمادي 10 %

المصادر والوثائق

الإضاءة
LED

المصادر والوثائق

نطاقات الضبط
طولي 100 mm؛ جانبي 100 mm؛ رأسي 30 mm

المصادر والوثائق

الأبعاد
700 × 332 × 305 mm

الطول × العرض × الارتفاع؛ دون التغليف.

المصادر والوثائق

الوزن
12.7 kg

دون مزوّد طاقة أو مسند رأس أو خيارات.

المصادر والوثائق

التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.


الطول × العرض × الارتفاع؛ دون التغليف.

دون مزوّد طاقة أو مسند رأس أو خيارات.



BQ 900 · تفصيل الجهاز


المصادر والوثائق

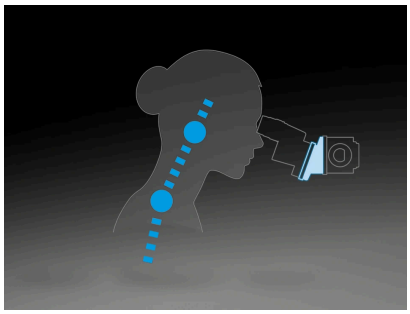

BQ 900 · رسم توضيحي من المصنّع

صورة توضيحية من المصنّع: قد تختلف التهيئة المعروضة عن التهيئة المسلَّمة.

المصادر والوثائق

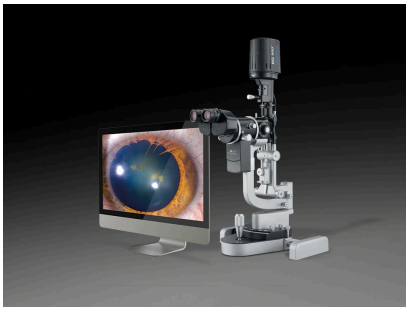

BQ 900 · تفصيل الجهاز

المصادر والوثائق

التنزيلات والموارد

- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  تم التحقق من المصدر في 04-10-2026
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  تم التحقق من المصدر في 04-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  تم التحقق من المصدر في 17-10-2026
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  تم التحقق من المصدر في 17-10-2026
- https://www.haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  تم التحقق من المصدر في 30-08-2026
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  تم التحقق من المصدر في 18-10-2026

أسئلتكم حول BQ 900

ما المواصفة «درجات التكبير» الموثقة لجهاز BQ 900؟

6.3× · 10× · 16× · 25× · 40× — التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

ما المواصفة «عدد درجات التكبير» الموثقة لجهاز BQ 900؟

5 — التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

ما التجهيز الذي ينبغي تأكيده لجهاز BQ 900؟

التجهيز القياسي؛ مع استبعاد الملحقات الاختيارية.

المصادر والوثائق

هل تشمل كل عملية توريد وحدة تصوير؟

لا. يمثل IM600 أوIM910 حلولًا مرتبطة يجب تحديدها ضمن التجهيز.

المصادر والوثائق

هل محول العدسات العينية المائلة قياسي؟

تعرضه الشركة كملحق اختياري.

المصادر والوثائق

منتجات ذات صلة




BI 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر كبلر ودرجتَي تكبير وإضاءة LED.

عرض المنتج



BM 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر كبلر ودرجتَي تكبير 10× و16×.

عرض المنتج



Elara 900

Haag-Streit

المصابيح الشقية

مصباح شقي بمجهر غاليليو وخمس درجات تكبير.

عرض المنتج



HS-5000

Huvitz

المصابيح الشقية

مصباح شقي بإضاءة برجية وبصريات غاليليو.

عرض المنتج

استكشف المجالات السريرية في كتالوج ASEM

تصفح المجالات القريبة في كتالوج ASEM. لا توسّع هذه الروابط استطبابات هذا الجهاز.

التشخيص والقياسات الحيوية

أكثر من جهاز، دعم مستمر

ناقش مشروعك مع ASEM: الاختيار والتركيب والتدريب والدعم الفني.



رسم توضيحي للخدمة

التركيب

ناقش شروط التركيب والتجهيز مع فريقنا الفني.

معرفة المزيد




رسم توضيحي للخدمة

التدريب

استفسر عن التدريب والتعريف بطريقة استخدام تجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

خدمة ما بعد البيع

تواصل مع ASEM للحصول على المساعدة الفنية والدعم المناسبين لتجهيزاتك.

معرفة المزيد



رسم توضيحي للخدمة

استشارة متخصصة

اعرض احتياجاتك السريرية لمناقشة اختيار التجهيزات الملائمة.

معرفة المزيد

التواصل مع مختص | استكشف جميع المنتجات | موقع الشركة المصنعة

direction@asem-medical.com · +21320092281

إصدار الوثيقة: 2d084b76fae7