세극등

BQ 900

갈릴레이 현미경, 다섯 배율 및 LED 조명을 갖춘 세극등.



BQ 900 · 장비 사진

출처 및 문서

견적 요청 제품 보기

생성일: 2026-11-10

> 이 자료는 ASEM이 작성했습니다. 제조사의 공식 문서나 사용 설명서를 대체하지 않습니다.

주요 장점

갈릴레이 현미경 광학계

6.3×~40× 범위의 다섯 배율 단계.

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

LED 세극 조명

세극등 관찰용 LED 조명.

LED 버전

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

세극등 영상 옵션

IM 600 또는 IM 910 모듈로 영상을 촬영합니다.

선택형 영상 모듈

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-10-17

세부 관찰

BQ 900 광학계로 전안부 상세 관찰을 지원합니다.




BQ 900 · 장비 상세 사진

출처 및 문서

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

정밀 조절

조작부와 조이스틱으로 필요한 조절을 손 가까이에서 수행합니다.

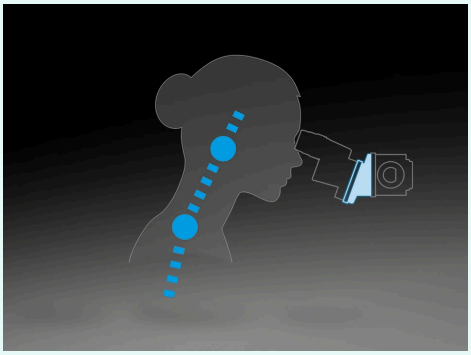

BQ 900 · 제조사 도해


제조사 예시 이미지: 표시된 구성은 실제 납품 구성과 다를 수 있습니다.

출처 및 문서

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

영상 기능 추가

문서화된 구성에 Haag-Streit 영상 모듈을 통합하여 관찰 내용을 저장합니다.

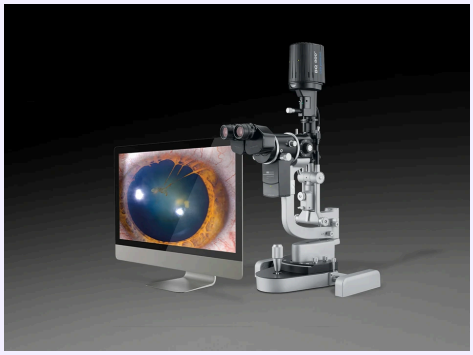

BQ 900 · 장비 상세 사진

출처 및 문서

출처 및 문서 · 출처 확인일: 2026-08-30

임상 관찰

세극등 검사를 위한 전용 광학계입니다.

조명 제어

검사 필요에 따라 관찰을 조절합니다.

검사자를 위한 인체공학

일상적인 조작을 고려한 구성입니다.

실제 활용 기능

다섯 배율로 관찰

Galilean 현미경은 6.3×, 10×, 16×, 25× 및 40×를 제공합니다. 단계별 전환으로 전체 보기에서 세부 관찰로 이동합니다.



BQ 900 · 장비 상세 사진

출처 및 문서

출처 및 문서

현미경과 조명의 결합

입체 현미경과 방향 조절식 세극 조명을 결합합니다. 세극 및 필터 설정으로 안구 조직 관찰을 조정합니다.

출처 및 문서

BQ 900: 안과의를 위한 기준 장비

BQ 900은 LED 조명, 세극 폭 0-14 mm, 길이 1-14 mm 및 조명 영역 0.2~8 mm를 제공합니다. 배율 6.3×~40×, +8~–8 디옵터 조절의 12.5× 접안렌즈와 13° 입체각으로 정밀하고 편안한 검사를 지원합니다.

부드러운 3차원 제어와 정밀 공간 조절을 332×305×700 mm의 컴팩트한 설계에 통합하여 안과의의 요구에 대응합니다.

경사 접안렌즈 어댑터

경사 접안렌즈 어댑터는 20도 관찰 각도로 편안한 자세를 제공하고 목의 긴장과 작업 피로를 줄입니다.

경사 광학계

긴 근무일에도 편안하고 피로가 적은 검사.

10년 보증

Haag-Streit 서비스 부문은 글로벌 네트워크와 현지 지원으로 수리, 정기 유지보수 및 부품 주문을 제공하여 고장·중단을 줄이고 장비 수명과 성능을 유지합니다. 서비스 엔지니어는 정기 교육을 통해 진단·수술·시뮬레이터와 EyeSuite를 지원합니다. 세계적인 서비스망으로 전문가의 환자 관리를 돕습니다.

더 원활한 작업 흐름

영상 기록 추가

제조사는 BQ 900의 영상 솔루션으로 IM600과 IM910을 명시합니다. 제공 여부와 기능은 설치된 모듈에 따라 달라집니다.

영상 모듈은 선택 사양이며 3D 라이선스가 포함되었다고 가정하지 않습니다.



BQ 900 · 장비 상세 사진

출처 및 문서

출처 및 문서

호환 안압측정 계획

호환되는 Goldmann AT 900 안압계를 세극등에 추가할 수 있습니다. 버전과 장착부는 선택 구성과 맞아야 합니다.

액세서리를 별도로 식별해야 하며, 식별되지 않은 카탈로그 품번 79와 동일하게 취급하지 않습니다.


출처 및 문서

일상 진료를 위한 설계

관찰 자세 조정

경사 접안렌즈 어댑터가 선택 사양으로 제공됩니다. 세극등에 영상 기능을 추가하지 않고 관찰 각도를 바꿉니다.

어댑터는 선택 사양입니다.

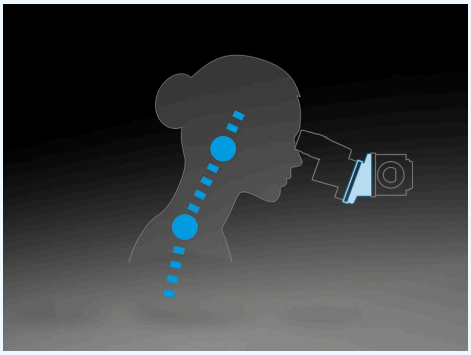

BQ 900 · 제조사 도해

제조사 예시 이미지: 표시된 구성은 실제 납품 구성과 다를 수 있습니다.

출처 및 문서

출처 및 문서

기술 사양 및 문서

브랜드
Haag-Streit

모델
BQ 900

기술
세극등

임상 용도
진단 및 생체계측

배율
6.3× · 10× · 16× · 25× · 40×

표준 구성으로, 선택 사양 액세서리는 제외됩니다.

출처 및 문서

배율 단계 수
5

표준 구성으로, 선택 사양 액세서리는 제외됩니다.

출처 및 문서

세극 폭
14 mm

출처 및 문서

세극 길이
14 mm

출처 및 문서

현미경 광학계
갈릴레이식

출처 및 문서

필터
파란색 · 무적색 녹색 · 회색 10 %

출처 및 문서

조명
LED

출처 및 문서

조절 범위
종방향 100 mm, 횡방향 100 mm, 수직 30 mm

출처 및 문서

크기
305 × 332 × 700 mm

길이 × 너비 × 높이이며, 포장은 제외됩니다.

출처 및 문서

무게
12.7 kg

전원 장치, 머리받침 및 선택 사양은 제외됩니다.

출처 및 문서

표준 구성으로, 선택 사양 액세서리는 제외됩니다.


길이 × 너비 × 높이이며, 포장은 제외됩니다.

전원 장치, 머리받침 및 선택 사양은 제외됩니다.



BQ 900 · 장비 상세 사진


출처 및 문서

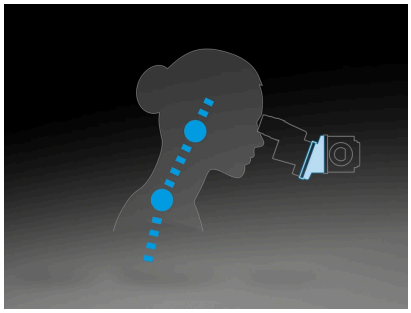

BQ 900 · 제조사 도해

제조사 예시 이미지: 표시된 구성은 실제 납품 구성과 다를 수 있습니다.

출처 및 문서

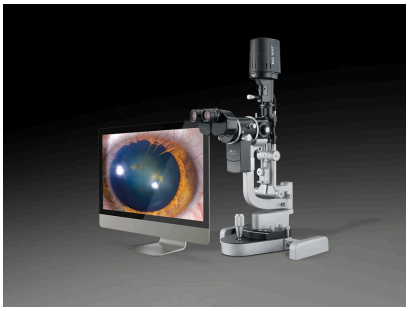

BQ 900 · 장비 상세 사진

출처 및 문서

다운로드 및 자료

- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  출처 확인일: 2026-10-04
- https://us.haag-streit.com/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  출처 확인일: 2026-10-04
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  출처 확인일: 2026-10-17
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  출처 확인일: 2026-10-17
- https://www.haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  출처 확인일: 2026-08-30
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  출처 확인일: 2026-10-18
- https://de.haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamps/BQ%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220589_04220_IFU_BQ_900_01_en_web.pdf
  출처 확인일: 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  출처 확인일: 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  출처 확인일: 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  출처 확인일: 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  출처 확인일: 2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamps/bq-900
  출처 확인일: 2026-10-18

BQ 900 관련 질문

BQ 900의 문서에 명시된 “배율” 사양은 무엇인가요?

6.3× · 10× · 16× · 25× · 40× — 표준 구성으로, 선택 사양 액세서리는 제외됩니다.

출처 및 문서

BQ 900의 문서에 명시된 “배율 단계 수” 사양은 무엇인가요?

5 — 표준 구성으로, 선택 사양 액세서리는 제외됩니다.

출처 및 문서

BQ 900의 어떤 구성을 확인해야 하나요?

표준 구성으로, 선택 사양 액세서리는 제외됩니다.

출처 및 문서

모든 납품에 영상 모듈이 포함되나요?

아닙니다. IM600 또는 IM910은 구성에 명시해야 하는 연계 솔루션입니다.

출처 및 문서

경사 접안렌즈 어댑터가 기본 제공되나요?

제조사는 선택 액세서리로 소개합니다.

출처 및 문서

관련 제품




BI 900

Haag-Streit

세극등

케플러 현미경, 두 배율 및 LED 조명을 갖춘 세극등.

제품 보기



BM 900

Haag-Streit

세극등

케플러 현미경과 10× 및 16× 배율을 갖춘 세극등.

제품 보기



Elara 900

Haag-Streit

세극등

갈릴레이 현미경과 다섯 배율을 갖춘 세극등.

제품 보기



HS-5000

Huvitz

세극등

타워형 조명과 갈릴레이 광학계를 갖춘 세극등.

제품 보기

ASEM 카탈로그의 임상 분야 살펴보기

ASEM 카탈로그의 인접 분야를 살펴보세요. 이 링크는 해당 장비의 적응증을 확대하지 않습니다.

진단 및 생체계측

장비를 넘어 지속적인 지원

장비 선정, 설치, 교육 및 기술 지원에 관해 ASEM과 상담하세요.



서비스 예시 이미지

설치

기술팀과 설치 조건 및 구성을 상담하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

교육

장비에 제공되는 교육과 사용 안내를 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

애프터서비스

장비에 적합한 기술 지원과 서비스를 ASEM에 문의하세요.

자세히 보기



서비스 예시 이미지

전문 상담

임상 요구 사항을 알려주시면 적합한 장비 선정을 함께 논의합니다.

자세히 보기

전문가에게 문의

모든 제품 살펴보기

제조사 웹사이트

+21320092281 · direction@asem-medical.com

문서 버전: 0e13913d9c48