
ASEM MEDICAL

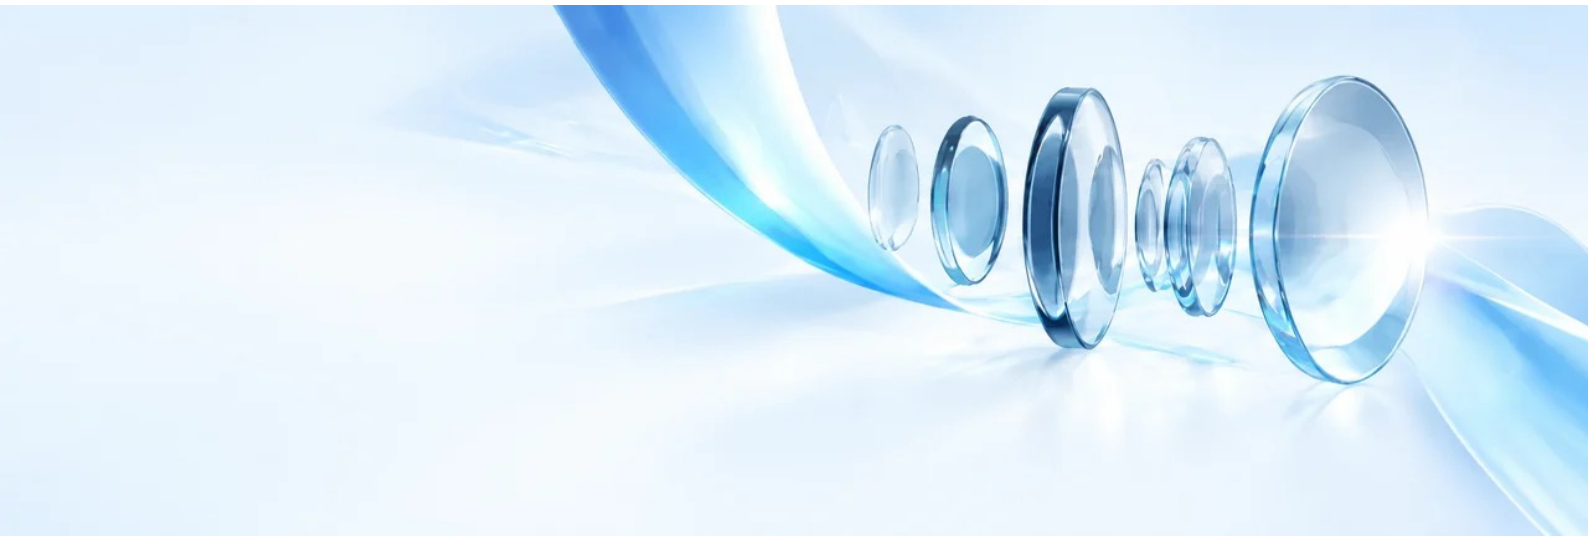

眼科设备目录

63 台设备

ASEM 公开设备精选。规格与可用配置须向制造商确认。本目录不能替代制造商的原始资料。

生成日期：2026-11-09

Huvitz | ASEM

OCTavius



五项检查集于一体的眼科影像平台。

已核实信息

多模态成像

涵盖OCT、眼底成像、血管成像、生物测量及地形图。

huvitz.com • 2026-10-05

快速OCT采集

OCT采集速度为每秒80,000次A扫描。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

HBM-1



结合光学生物测量与角膜地形图，用于术前评估。

已核实信息

光学生物测量

眼轴长度测量范围为14至40 mm。

www.huvitz.com • 2026-10-05

Placido角膜地形图

通过24环分析角膜表面形态。

www.huvitz.com • 2026-10-05

人工晶状体计算

集成人工晶状体计算与Zernike分析。

www.huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-9000A



一台设备结合屈光检查与眼表评估。

已核实信息

自动验光

球镜范围-30至+25 D，柱镜最高12 D。

huvitz.com • 2026-10-05

眼表评估

支持睑板腺成像与泪膜破裂时间分析。

huvitz.com • 2026-10-05

周边角膜曲率测量

测量角膜中央及周边曲率。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Eyestar 900



采用EyeSuite系统的光学生物测量与角膜曲率检查。

已核实信息

扫频OCT生物测量

通过扫频OCT进行从角膜到视网膜的生物测量。

haag-streit.com • 2026-10-17

角膜形态图

通过地形图及厚度测量评估角膜。

haag-streit.com • 2026-10-17

自动化数据采集

自动采集流程用于双眼测量。

haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Elara 900



采用伽利略显微镜的五档变倍裂隙灯。

已核实信息

投影式裂隙照明

通过投影照明观察眼部结构。

us.haag-streit.com • 2026-10-17

红外腺体评估

采用红外照明评估睑板腺。

us.haag-streit.com • 2026-10-17

电动检查控制

电动控制仪器高度与放大倍率。

us.haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • us.haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 3台设备



可配置3台检查仪器的综合验光台。

已核实信息

3仪器工位

台面可布置3台检查仪器。

www.fiso.info • 2026-10-17

电动定位

电动调节台面与座椅。

www.fiso.info • 2026-10-17

电磁锁定

锁定台面与综合验光仪支臂。

www.fiso.info • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® Plus



等离子技术结合3支手柄，适配不同强度等级。

已核实信息

等离子技术

通过聚焦等离子电弧传递能量。

gruppogmv.com • 2026-10-17

3支手柄

三支手柄：白色、绿色及红色。

gruppogmv.com • 2026-10-17

非接触应用

在不直接接触皮肤的情况下传递能量。

gruppogmv.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • gruppogmv.com

R-Evo Smart® CR



支持超声乳化及前、后段玻璃体切除。

已核实信息

联合手术平台

结合超声乳化与前、后段玻璃体切除。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

双吸引系统

可选择蠕动泵或Venturi泵。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

超声乳化

约40 kHz下支持连续、脉冲或爆发模式。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.bvimedical.com

Haag-Streit | ASEM

METIS 900



眼科手术显微镜配备电动变焦与垂直调焦。

已核实信息

同轴红光反射

同轴红光反射照明用于手术观察。

us.haag-streit.com • 2026-10-17

电动观察倾角

电动倾斜调节手术观察角度。

us.haag-streit.com • 2026-10-17

手控与脚控

通过手控或脚控操作变焦与调焦。

依配置而定

us.haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • us.haag-streit.com

Easyvisus MS33 — 3台设备



可配置3台检查仪器的综合验光台。

已核实信息

3仪器工位

台面可布置3台检查仪器。

www.fiso.info • 2026-10-17

电动定位

电动调节台面与座椅。

www.fiso.info • 2026-10-17

电磁锁定

锁定台面与综合验光仪支臂。

www.fiso.info • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Curve



可配置2台检查仪器的综合验光台。

已核实信息

2仪器工位

台面可布置2台检查仪器。

www.fiso.info • 2026-10-17

台面选择

可选双仪器旋转式或滑动式版本。

依配置而定

www.fiso.info • 2026-10-17

电磁锁定

锁定台面与综合验光仪支臂。

www.fiso.info • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

GMV | ASEM

Plexr® PRO



等离子技术结合2支手柄，适配不同强度等级。

已核实信息

等离子技术

通过聚焦等离子电弧传递能量。

gruppogmv.com • 2026-10-17

2支手柄

两支手柄：P One与P Two。

gruppogmv.com • 2026-10-17

非接触应用

在不直接接触皮肤的情况下传递能量。

gruppogmv.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • gruppogmv.com

Echoson | ASEM

PIROP A+B+CCT



一台眼科扫描设备结合生物测量、超声及角膜测厚。

已核实信息

A型生物测量

支持眼轴长度测量及人工晶状体度数计算。

echoson.pl • 2026-10-17

B型超声

通过超声显示眼球内部结构。

echoson.pl • 2026-10-17

中央角膜厚度测量

采用超声方式测量角膜厚度。

echoson.pl • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • echoson.pl

Huvitz | ASEM

HTR-1A



综合平台涵盖屈光、角膜与眼压检查。

已核实信息

验光与角膜曲率

将两项屈光检查测量集于一体。

huvitz.com • 2026-10-05

非接触眼压测量

以非接触方式测量眼内压。

huvitz.com • 2026-10-05

角膜厚度测量

同一设备完成角膜厚度测量。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

HOCT-1 / HOCT-1F



同一平台结合频域OCT与免散瞳眼底成像。

已核实信息

频域OCT

OCT成像轴向分辨率为7 μm。

huvitz.com • 2026-10-05

集成眼底成像

无需散瞳即可拍摄眼底图像。

仅限 HOCT-1F

huvitz.com • 2026-10-05

影像管理

通过HIIS-1软件管理检查。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

HFC-1



支持全景采集的免散瞳眼底成像。

已核实信息

免散瞳成像

以45° 视野采集视网膜图像。

www.huvitz.com • 2026-10-05

全景视图

支持眼底图像全景拼接。

www.huvitz.com • 2026-10-05

小瞳孔采集

瞳孔直径低至3.3 mm时可进行采集。

www.huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

HDR-9000



用于主觉验光与测量数据传输的数字综合验光仪。

已核实信息

主觉验光

用于视功能检查的球镜范围为-29至+26.75 D。

huvitz.com • 2026-10-05

棱镜矫正

棱镜度数最高20 Δ。

huvitz.com • 2026-10-05

无线连接

通过Wi-Fi或RS-232交换数据。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

HVS-1



支持远距离双眼屈光筛查。

已核实信息

双眼筛查

远距离测量双眼屈光状态。

huvitz.com • 2026-10-05

屈光测量范围

球镜范围-8至+8 D，柱镜最高3 D。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

HS-7500



采用伽利略光学系统，提供五档裂隙灯检查倍率。

已核实信息

五档放大倍率

提供6×、10×、16×、25×、40×观察倍率。

huvitz.com • 2026-10-04

检查裂隙

裂隙开口最大14 × 14 mm。

huvitz.com • 2026-10-04

观察滤镜

配备钴蓝及绿色检查滤镜。

huvitz.com • 2026-10-04

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

HRK-8100A



结合自动验光及中央、周边角膜曲率测量。

已核实信息

自动验光

球镜范围-30至+25 D，柱镜最高12 D。

huvitz.com • 2026-10-05

周边角膜检查

一次检查涵盖中央与周边角膜曲率。

huvitz.com • 2026-10-05

镜片曲率测量

测量接触镜曲率。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lenstar 900



配备角膜曲率测量及EyeSuite软件的光学生物测量仪。

已核实信息

OLCR光学生物测量

眼轴测量用于辅助人工晶状体规划。

haag-streit.com • 2026-10-17

双区域角膜测量

采用双区域角膜曲率测量评估角膜曲率。

haag-streit.com • 2026-10-17

EyeSuite人工晶状体规划

通过EyeSuite IOL进行人工晶状体计算与选择。

依软件配置而定

haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Refractor 900



支持数据连接的主觉综合验光仪。

已核实信息

主觉验光

通过镜片调节进行主觉验光检查。

haag-streit.com • 2026-10-17

触屏检查控制

通过触屏面板操作检查。

haag-streit.com • 2026-10-17

临床数据交换

与诊断设备及患者记录交换数据。

需确认系统兼容性

haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 900



支持静态视野检查，其他功能依配置而定。

已核实信息

全视野静态检查

静态测试程序覆盖中央及周边视野。

haag-streit.com • 2026-10-17

动态视野检查

动态检查依版本及许可而定。

选项依版本而定

haag-streit.com • 2026-10-17

整体进展分析

对连续视野检查进行整体进展分析。

haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Octopus 600



结合SAP静态视野与Pulsar视野检查的视野计。

已核实信息

中央静态视野检查

采用白对白刺激进行中央视野检查。

haag-streit.com • 2026-10-17

整体进展分析

回顾连续视野检查及其整体进展。

haag-streit.com • 2026-10-17

无需暗室

可在暗室之外进行检查。

haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BQ 900



采用伽利略显微镜、五档倍率及LED照明的裂隙灯。

已核实信息

伽利略显微光学

提供6.3×至40×五档放大倍率。

haag-streit.com • 2026-10-17

LED裂隙照明

通过LED照明进行裂隙灯观察。

LED版本

de.haag-streit.com • 2026-10-17

裂隙灯成像选项

通过IM 600或IM 910模块采集图像。

选配成像模块

haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

BI 900



采用开普勒显微镜、双档倍率及LED照明的裂隙灯。

已核实信息

开普勒显微光学

裂隙灯观察提供10×与16×两档倍率。

us.haag-streit.com • 2026-10-17

集成对比度滤镜

集成增强对比度滤镜用于常规检查。

us.haag-streit.com • 2026-10-17

裂隙灯成像选项

通过BI 900 Imaging Set记录检查。

选配成像套件

us.haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.haag-streit.com

Haag-Streit | ASEM

Imaging Module 910



用于兼容裂隙灯的成像模块，具体配置需与ASEM确认。

已核实信息

辅助图像采集

自动曝光与光圈控制辅助图像采集。

需使用兼容裂隙灯

haag-streit.com • 2026-10-17

便捷相机控制

相机与照明控制设于操纵杆旁。

haag-streit.com • 2026-10-17

两种集成模式

支持独立运行或集成于EyeSuite。

haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • haag-streit.com

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 — 2台设备



可配置2台检查仪器的综合验光台。

已核实信息

2仪器工位

台面可布置2台检查仪器。

www.fiso.info • 2026-10-17

电动定位

电动调节台面与座椅。

www.fiso.info • 2026-10-17

电磁锁定

锁定台面与综合验光仪支臂。

www.fiso.info • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 3台设备



可配置3台检查仪器的综合验光台。

已核实信息

3仪器工位

台面可布置3台检查仪器。

www.fiso.info • 2026-10-17

轮椅检查空间

可打开台面，便于患者坐在轮椅上接受检查。

www.fiso.info • 2026-10-17

电动可调座椅

PRIMA座椅支持电动高度调节。

www.fiso.info • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus RM64 Compact — 2台设备



可配置2台检查仪器的综合验光台。

已核实信息

2仪器工位

台面可布置2台检查仪器。

www.fiso.info • 2026-10-17

轮椅检查空间

可打开台面，便于患者坐在轮椅上接受检查。

www.fiso.info • 2026-10-17

电动可调座椅

PRIMA座椅支持电动高度调节。

www.fiso.info • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus MS33 — 2台设备



可配置2台检查仪器的综合验光台。

已核实信息

2仪器工位

台面可布置2台检查仪器。

www.fiso.info • 2026-10-17

电动定位

电动调节台面与座椅。

www.fiso.info • 2026-10-17

电磁锁定

锁定台面与综合验光仪支臂。

www.fiso.info • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus One



可配置1台检查仪器的综合验光台。

已核实信息

1仪器工位

台面可布置1台检查仪器。

www.fiso.info • 2026-10-17

固定高度台面

支臂可在各位置进行机械锁定。

www.fiso.info • 2026-10-17

电动可调座椅

PRIMA座椅支持电动高度调节。

www.fiso.info • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Easyvisus Two



可配置2台检查仪器的综合验光台。

已核实信息

2仪器工位

台面可布置2台检查仪器。

www.fiso.info • 2026-10-17

仪器居中

V形台面配备仪器居中机构。

www.fiso.info • 2026-10-17

电动可调座椅

PRIMA座椅支持电动高度调节。

www.fiso.info • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Trio



可配置3台检查仪器的综合验光台。

已核实信息

3仪器工位

台面可布置3台检查仪器。

www.fiso.info • 2026-10-17

电动定位

电动调节台面与座椅。

www.fiso.info • 2026-10-17

电磁锁定

锁定台面与综合验光仪支臂。

www.fiso.info • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

R-Evo Smart® S



支持超声乳化及前段玻璃体切除。

已核实信息

眼前段手术

支持超声乳化及前段玻璃体切除。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

双吸引系统

可选择蠕动泵或Venturi泵。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

超声乳化

约40 kHz下支持连续、脉冲或爆发模式。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.bvimedical.com

R-Evo Smart® E



支持超声乳化及前段玻璃体切除。

已核实信息

眼前段手术

支持超声乳化及前段玻璃体切除。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

蠕动泵吸引

通过蠕动泵进行吸引。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

超声乳化

约40 kHz下支持连续、脉冲或爆发模式。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution CR



支持超声乳化及前、后段玻璃体切除。

已核实信息

联合手术平台

结合超声乳化与前、后段玻璃体切除。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

双吸引系统

可选择蠕动泵或Venturi泵。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

超声乳化

约40 kHz下支持连续、脉冲或爆发模式。

www.bvimedical.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.bvimedical.com

BVI Medical | ASEM

R-Evolution



手术功能可配置的超声乳化平台。

已核实信息

液流管理

支持基于流量或负压的吸引方式选择。

依配置而定

www.bvimedical.com • 2026-10-17

超声输出

超声乳化支持脉冲及爆发模式。

依配置而定

www.bvimedical.com • 2026-10-17

手术照明

三个独立LED输出端口，配备彩色滤镜。

依配置而定

www.bvimedical.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • www.bvimedical.com

F.I.S.O. | ASEM

Table Hercule



请联系 ASEM 获取此型号的已核实信息。

技术规格有待确认。

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Trial Lenses set with Metal Rim in Beech Wood Case



木质试镜箱内含236片用于主觉验光的试镜片。

已核实信息

主觉验光

通过试镜片组合进行光学矫正检查。

www.fiso.info • 2026-10-05

236片试镜片

木质箱内配备236片试镜片。

www.fiso.info • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

51-B - 236 B Ensembles de lentilles d'essai



ABS试镜箱内含236片用于主觉验光的试镜片。

已核实信息

主觉验光

通过试镜片组合进行光学矫正检查。

www.fiso.info • 2026-10-05

236片试镜片

ABS箱内配备236片试镜片。

www.fiso.info • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

lit chirurgical 77FY



适用于门诊手术的分段式手术椅。

已核实信息

手术体位调节

支持背部、腿部及倾角调节。

www.frastema.com • 2026-10-05

移动与制动

配备可转向脚轮与脚控刹车。

www.frastema.com • 2026-10-05

灵活供电

依配置提供市电或24 V电池版本。

依配置而定

www.frastema.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

92-FA



配有脚轮和可调座面的座凳，适用于诊室工作位。

已核实信息

气动座面调节

通过气动机构，将座面高度在 52 至 72 cm 范围内调节。

FISO 92-FA 座凳。座面包覆材料及交付配置须确认。

fiso.info • 2026-10-18

软垫圆形座面

带软垫的圆形座面，直径为 33 cm。

fiso.info • 2026-10-18

五脚底座

直径 50 cm 的镀铬底座，配有脚轮。

fiso.info • 2026-10-18

查看详情

查看制造商来源 • fiso.info

F.I.S.O. | ASEM

Panvisus Rondo



Panvisus Rondo 双仪器检查台，具体配置须确认。

已核实信息

双仪器台面

Rondo 系列台面可容纳两台仪器。

Panvisus Rondo 系列的共同特性。台面型号、升降方式及附件须确认。

www.fiso.info • 2026-10-18

台面形式选择

可选 V 形或滑动台面，取决于具体型号。

www.fiso.info • 2026-10-18

高度调节依型号而定

台面为固定高度或电动升降，取决于具体版本。

www.fiso.info • 2026-10-18

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

Huvitz | ASEM

Réfracteur HDR-7100P



用于远近视力主觉检查的综合验光仪。

已核实信息

主觉验光

用于视功能检查的球镜范围为-29至+26.75 D。

huvitz.com • 2026-10-05

近视力检查

工作距离可在35至70 cm间调节。

huvitz.com • 2026-10-05

棱镜矫正

棱镜度数最高20 Δ。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Haag-Streit | ASEM

Lampe à fente BM-900



采用开普勒显微镜，提供10×与16×倍率的裂隙灯。

已核实信息

开普勒显微光学

裂隙灯观察提供10×与16×两档倍率。

haag-streit.com • 2026-10-17

LED裂隙照明

通过LED照明进行裂隙灯观察。

LED版本

jp.haag-streit.com • 2026-10-17

单手定位

通过单手操纵杆完成仪器三轴定位。

jp.haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre Digital



采用Hartmann技术测量眼镜片及接触镜。

已核实信息

Hartmann分析

测量球镜、柱镜及棱镜度数。

huvitz.com • 2026-10-05

接触镜测量

支持硬性与软性接触镜测量。

huvitz.com • 2026-10-05

宽范围光学测量

球镜范围-25至+25 D，柱镜最高10 D。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

HIIS-1 (HIS-1)



用于查看兼容设备所产生检查数据的软件。

已核实信息

单项检查视图

显示单项检查，便于查看其数据。

手册使用 HIS-1 和 HIIS-1 两种名称。版本、许可证、模块及连接设备须确认。

optomedical.eu • 2026-10-18

六项检查视图

通过六项检查视图，将检查结果并列查看。

optomedical.eu • 2026-10-18

DICOM 数据交换

DICOM 协议用于与兼容系统交换数据。

optomedical.eu • 2026-10-18

查看详情

查看制造商来源 • optomedical.eu

Haag-Streit | ASEM

AT 900



AT 900 系列 Goldmann 压平眼压计。

已核实信息

Goldmann 测量原理

采用压平法测量眼内压。

AT 900 系列的共同特性。R、T 或 BQ 安装方式及裂隙灯兼容性须确认。

uk.haag-streit.com • 2026-10-18

测量范围

文献记载的眼压范围为 0 至 80 mmHg。

uk.haag-streit.com • 2026-10-18

安装方式须确认

须确认 R、T 或 BQ 安装方式及其兼容性。

uk.haag-streit.com • 2026-10-18

查看详情

查看制造商来源 • uk.haag-streit.com

Huvitz | ASEM

Auto-réfkeratomètre HRK-1



结合验光、角膜曲率测量及接触镜验配辅助功能。

已核实信息

验光与角膜检查

一台设备结合屈光度与角膜曲率测量。

huvitz.com • 2026-10-05

接触镜验配

辅助进行接触镜验配。

huvitz.com • 2026-10-05

垂直跟踪

垂直定位跟踪范围为±15 mm。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Frontofocometre HLM-7000P



支持眼镜片与接触镜测量。

已核实信息

眼镜片测量

测量球镜、柱镜及棱镜度数。

huvitz.com • 2026-10-05

接触镜测量

支持硬性与软性接触镜测量。

huvitz.com • 2026-10-05

宽范围光学测量

球镜范围-25至+25 D，柱镜最高10 D。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

Projecteur de test HCP-7000



用于诊室视功能检查的LED投影仪。

已核实信息

多种视功能测试

提供41种视标及34种显示遮罩。

huvitz.com • 2026-10-05

LED投影

采用LED光源投影视标。

huvitz.com • 2026-10-05

检查距离

适用2.5－8 m检查距离。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

Ecran Numérique HDC-9100N/PF



通过全高清LCD屏幕显示数字视标。

已核实信息

全高清视标

24英寸LCD屏幕，分辨率1920 × 1080。

huvitz.com • 2026-10-05

检查距离

支持最远6 m距离的视功能测试显示。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

Champ visuel HVF-100



通过白对白静态视野检查评估视野。

已核实信息

静态视野检查

支持白对白视野检查。

huvitz.com • 2026-10-05

最大90° 视野

视野检查范围最高90° 。

huvitz.com • 2026-10-05

Goldmann III视标

采用Goldmann III规格刺激视标进行视野测试。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

Tonomètre à air HNT-1/1P



采用非接触式眼压计测量眼内压。

已核实信息

非接触眼压测量

以非接触方式测量眼内压。

huvitz.com • 2026-10-05

眼压测量范围

眼压测量范围为0 - 60 mmHg。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

Huvitz | ASEM

Topographe Optique Cornéen Complet



角膜地形图结合角膜曲率测量与Zernike分析。

已核实信息

角膜形态图

绘制角膜表面地形图。

huvitz.com • 2026-10-05

Zernike分析

使用Zernike项分析角膜像差。

huvitz.com • 2026-10-05

集成角膜曲率测量

同次检查完成角膜曲率测量。

huvitz.com • 2026-10-05

查看详情

查看制造商来源 • huvitz.com

F.I.S.O. | ASEM

Unité 2 postes



请联系 ASEM 获取此型号的已核实信息。

技术规格有待确认。

查看详情

查看制造商来源 • www.fiso.info

Haag-Streit | ASEM

EIBOS 2



用于兼容手术显微镜的广角眼底观察附件。

已核实信息

非接触广角观察

通过手术显微镜进行广角眼底观察。

需使用兼容显微镜

haag-streit.com • 2026-10-17

集成图像倒像器

同一系统集成调焦与图像倒像功能。

haag-streit.com • 2026-10-17

手动调焦

通过侧面操纵杆手动调节焦点。

haag-streit.com • 2026-10-17

查看详情

查看制造商来源 • haag-streit.com

Huvitz HS-7000 — 裂隙灯



采用伽利略光学系统的五档变倍裂隙灯。

已核实信息

五档放大倍率

提供6×、10×、16×、25×、40×观察倍率。

huvitz.com • 2026-10-06

检查裂隙

裂隙开口最大14 × 14 mm。

huvitz.com • 2026-10-06

观察滤镜

配备钴蓝及绿色检查滤镜。

huvitz.com • 2026-10-06

查看详情

查看制造商来源 • www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5000 — 裂隙灯



结合塔式照明与伽利略光学系统的裂隙灯。

已核实信息

五档放大倍率

提供6.5×、11×、16×、23.2×、39.3×观察倍率。

huvitz.com • 2026-10-06

检查裂隙

裂隙开口最大14 × 14 mm。

huvitz.com • 2026-10-06

塔式照明

照明倾角可在0° 至20° 间分档调节。

huvitz.com • 2026-10-06

查看详情

查看制造商来源 • www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HS-5500 — 裂隙灯



采用一体式照明与伽利略光学系统的裂隙灯。

已核实信息

五档放大倍率

提供6.5×、11×、16×、23.2×、39.3×观察倍率。

huvitz.com • 2026-10-06

检查裂隙

裂隙开口最大14 × 14 mm。

huvitz.com • 2026-10-06

一体式照明

照明倾角可在0°至20°间连续调节。

huvitz.com • 2026-10-06

查看详情

查看制造商来源 • www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz HDC-7000 — 视力测试系统



用于屈光及双眼视功能检查的数字测试系统。

已核实信息

双眼视功能

支持立体视、融合及注视差异测试。

www.huvitz.com • 2026-10-06

可定制测试

支持对比度、遮罩、红绿及镜像显示。

www.huvitz.com • 2026-10-06

PC平台安装

在另行确定的兼容PC与屏幕上进行测试。

PC与屏幕需另配

www.huvitz.com • 2026-10-06

查看详情

查看制造商来源 • www.huvitz.com

Huvitz | ASEM

Huvitz CIT-4000 — 电动升降台



用于调整检查设备位置的电动仪器台。

已核实信息

电动调节

电动调节仪器高度。

www.huvitz.com • 2026-10-06

诊室移动

脚轮便于在检查工位之间移动仪器台。

www.huvitz.com • 2026-10-06

灵活操作

依版本支持手控或脚踏控制。

依配置而定

www.huvitz.com • 2026-10-06

查看详情

查看制造商来源 • www.huvitz.com