验光工作台

Easyvisus Curve

可配置2台检查仪器的综合验光台。

Easyvisus Curve 是双仪器固定高度验光组合台。工作台按编号为旋转或滑动方式，其中一种旋转配置带抽屉。工作台及支臂采用电磁锁定。PRIMA 座椅保留独立于固定台面的电动升降，未宣称台面可电动垂直移动。



Easyvisus Curve • 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-10

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

2仪器工位

台面可布置2台检查仪器。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

台面选择

可选双仪器旋转式或滑动式版本。

依配置而定

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

电磁锁定

锁定台面与综合验光仪支臂。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

布局 Easyvisus Curve 工作站

制造商视图展示工作站的具体配置及仪器取用方式。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30


定位台面

文档所述台面移动便于在 Easyvisus Curve 上切换设备。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

规划布局

官方图纸注明占地尺寸，帮助准备 Easyvisus Curve 的安装。

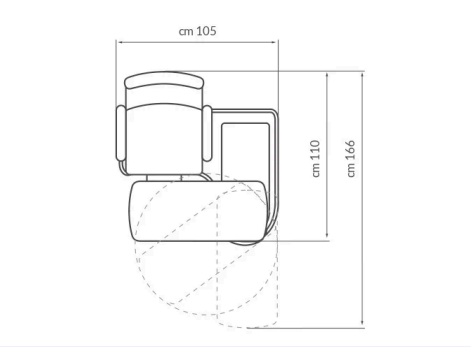

Easyvisus Curve · 安装布局图

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

人体工学

围绕诊疗工作站设计的布局。

仪器有序布置

设备放置于专用组合台。

工作站调节

可用移动方式便于调整配置。

实际应用能力

验光组合台

来源与文档

更流畅的工作流程

适合所选仪器的工作台

400500 与 400530 为旋转版，400530 带抽屉。400550 配滑动工作台。它们保持固定高度，不同于可电动垂直调节的 RM64 和 MS33。400530 抽屉可容纳目录所列试镜片附件；镜片组及仪器须分别注明。

来源与文档

已记录的控制与定位

制造商记录了旋转台面及支臂的电磁锁定。此处未描述与 RM64、MS33 相同的 LCD 面板或操纵杆。电动高度调节属于标准 PRIMA 座椅，而非台面。座椅升降脚踏列于可选附件。

来源与文档

专为日常诊疗设计

标准座椅及可选附件

标准 PRIMA 可电动调节高度，采用黑色仿皮包覆，不含脚托。可翻起脚托、其他包覆材料及更换其他座椅型号属于已记录选项。座椅版本须在 ASEM 报价中确认。原始照片可能展示脚托、验光头支臂或其他选配附件；可见并不证明包含在内。设备和附件须分别列明。

来源与文档

照明及仪器供电

铝制立柱配有 LED 阅读灯及视力投影仪支撑板。主单元记录有裂隙灯变压器电源。不类比 RM64 或 MS33 增加可调环境 LED。底座为喷漆钢材，带可调支脚。这些页面未说明整套设备的电源电压及频率。

来源与文档



Easyvisus Curve · 设备实景图

来源与文档



Easyvisus Curve · 设备实景图

来源与文档

安装与配置选择

400500S、400530S 及 400550S 为选配左手版。图纸分别展示旋转与滑动布局，不据此推断可调台面高度或统一整体尺寸。这些页面未列重量。布局、操作方向及附件须在 ASEM 报价中确认。

来源与文档

技术规格与文档

品牌
F.I.S.O.

型号
Easyvisus Curve

技术
验光组合台

临床用途
专用技术

仪器容量
2

来源与文档

座椅高度
电动调节；标配 Prima 座椅

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

工作台锁定
工作台与支臂：电磁锁定

来源与文档

工作台移动
旋转或平移，视具体型号而定

来源与文档


工作站照明
LED 阅读灯

来源与文档

底座
喷漆钢材；可调支脚

来源与文档

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。



Easyvisus Curve · 安装布局图

来源与文档

下载与资源

制造商资料

PDF · 15,672 kB

来源与文档

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  来源核验日期：2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  来源核验日期：2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-curve_493/
  来源核验日期：2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-18

关于 Easyvisus Curve 的常见问题

Easyvisus Curve 已记录的“仪器容量”规格是什么？

2

来源与文档

Easyvisus Curve 已记录的“座椅高度”规格是什么?

电动调节；标配 Prima 座椅 — 脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

Easyvisus Curve 的哪些配置需要确认?

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

在哪里可以找到 Easyvisus Curve 的文档?

制造商资料 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

来源与文档

台面高度为电动调节吗?

手册描述的是固定高度台面。电动高度调节针对PRIMA座椅，不应与台面混淆。

来源与文档

提供哪些台面配置?

400500指旋转台面，400530指带抽屉的旋转台面，400550指滑动台面。这些型号并不表示台面可电动升降。

来源与文档

Curve文档列明了哪些照明?

铝制立柱的文档配置为LED阅读灯和视标投影仪支架。不类推加入RM64的环境照明或LCD面板。

来源与文档

相关产品



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

验光工作台

Panvisus Rondo 双仪器检查台，具体配置须确认。

查看产品



Easyvisus MS33 — 2台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置2台检查仪器的综合验光台。

查看产品



Easyvisus MS33 — 3台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置3台检查仪器的综合验光台。

查看产品



Easyvisus One

F.I.S.O.

验光工作台

可配置1台检查仪器的综合验光台。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

专科技术

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：d95c026b251f