验光工作台

# Easyvisus MS33 — 2台设备

可配置2台检查仪器的综合验光台。

双仪器版 Easyvisus MS33 提供带或不带抽屉的旋转台，或手动滑动台。所有已记录配置均有电动台面高度调节、LCD 面板、操纵杆及电动 PRIMA 座椅。不能与电动滑动 RM64 混淆，此 MS33 不承诺电动滑动或自动定位。



Easyvisus MS33 · 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-09

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

# 核心优势

### 2仪器工位

台面可布置2台检查仪器。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

### 电动定位

电动调节台面与座椅。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

### 电磁锁定

锁定台面与综合验光仪支臂。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

### 布局 Easyvisus MS33 — 双仪器工作站

制造商视图展示工作站的具体配置及仪器取用方式。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30


### 定位台面

文档所述台面移动便于在 Easyvisus MS33 — 双仪器配置上切换设备。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

### 规划布局

官方图纸注明占地尺寸，帮助准备 Easyvisus MS33 — 双仪器配置的安装。

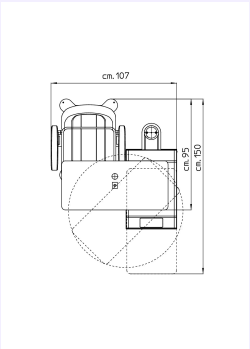


Easyvisus MS33 · 安装布局图

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

### 人体工学

围绕诊疗工作站设计的布局。

### 仪器有序布置

设备放置于专用组合台。

### 工作站调节

可用移动方式便于调整配置。

## 实际应用能力

### 验光组合台

来源与文档

## 更流畅的工作流程

### 适合所选仪器的工作台

400200 配双仪器旋转台。400230 在旋转台上增加带 148 片试镜片木托盘的抽屉。400250 为手动滑动。三个编号均可电动垂直调节，但这不意味着滑动也是电动。不因标称容量假定包括设备或镜片组。

来源与文档

### 已记录的控制与定位

LCD 面板可自定义标志。操纵杆控制座椅及工作台升降和锁定。制造商记录了旋转台面及台面支臂的电磁锁定。高度电动调节与具体编号所用旋转或滑动方式不同。

来源与文档

# 专为日常诊疗设计

## 标准座椅及可选附件

标准 PRIMA 可电动调节高度，采用黑色仿皮包覆，不含脚托。可翻起脚托、其他包覆材料及更换其他座椅型号属于已记录选项。座椅版本须在 ASEM 报价中确认。原始照片可能展示脚托、验光头支臂或其他选配附件；可见并不证明包含在内。设备和附件须分别列明。

来源与文档

## 照明及仪器供电

铝制立柱配有可调环境 LED、LED 阅读灯及视力投影仪支撑板。主单元包括裂隙灯变压器电源。喷漆钢制底座配可调支脚。额外仪器电源属于附件，不自动视为包含。不能据此推算整台组合台的输入电压或频率。

来源与文档



Easyvisus MS33 · 设备实景图

来源与文档



Easyvisus MS33 · 设备实景图

来源与文档

## 安装与配置选择

左手版 400200S、400230S 及 400250S 为选配。图纸区分旋转台和滑动台，不将不同位置转换为单一整体尺寸。不类比 RM64 增加 236 片镜片托盘桌体。这些页面仍未记录重量、频率及高度数值范围。

来源与文档

# 技术规格与文档

**品牌**
F.I.S.O.

**型号**
Easyvisus MS33 — 2台设备

**技术**
验光组合台

**临床用途**
专用技术

**仪器容量**
2

来源与文档

**座椅高度**
电动调节；标配 Prima 座椅

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

**工作台高度**
电动调节

来源与文档

**工作台锁定**
工作台与支臂：电磁锁定

来源与文档

**工作台移动**
旋转或平移，视具体型号而定

由厂家配置选择决定；不能默认任何自动功能选配已安装。

来源与文档

### 工作站照明

环境 LED 灯 • LED 阅读灯

来源与文档

### 控制装置

LCD 面板；用于调节及锁定的操纵杆

来源与文档


### 底座

喷漆钢材；可调支脚

来源与文档

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

由厂家配置选择决定；不能默认任何自动功能选配已安装。




Easyvisus MS33 • 安装布局图

来源与文档

# 下载与资源

### 制造商资料

PDF • 15,672 kB

来源与文档

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-2-instruments-_447/
  来源核验日期：2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-2-instruments-_447/
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-2-instruments-_447/
  来源核验日期：2026-10-17

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-ms33-unit-2-instruments-_447/
  来源核验日期：2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-18

# 关于 Easyvisus MS33 — 2台设备 的常见问题

### Easyvisus MS33 — 2台设备 已记录的“仪器容量”规格是什么?

2

来源与文档

### Easyvisus MS33 — 2台设备 已记录的“座椅高度”规格是什么?

电动调节；标配 Prima 座椅 — 脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

### Easyvisus MS33 — 2台设备 的哪些配置需要确认?

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

### 在哪里可以找到 Easyvisus MS33 — 2台设备 的文档?

制造商资料 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

来源与文档

### MS33各版本的台面有何区别?

400200采用旋转台面，400230增加台面抽屉，400250采用手动滑动。高度为电动调节。

来源与文档

### 400230的抽屉有哪些文档说明?

400230设有带148片试镜片木托盘的抽屉。平面或弯月形镜片托盘列为附件，不默认随附。

来源与文档

### 哪些配置可提供左手型?

400200、400230、400250分别提供左手型选配版本400200S、400230S、400250S。

来源与文档

## 相关产品



### Panvisus Rondo

F.I.S.O.

验光工作台

Panvisus Rondo 双仪器检查台，具体配置须确认。

查看产品



### Easyvisus Curve

F.I.S.O.

验光工作台

可配置2台检查仪器的综合验光台。

查看产品



## Easyvisus MS33 — 3台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置3台检查仪器的综合验光台。

查看产品



## Easyvisus One

F.I.S.O.

验光工作台

可配置1台检查仪器的综合验光台。

查看产品

# 探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

专科技术

# 不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

### 安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

### 培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

### 售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

### 专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：cb547d5c9b64