验光工作台

Easyvisus One

可配置1台检查仪器的综合验光台。

Easyvisus One 是 F.I.S.O. 的单仪器固定高度验光组合台。支臂可在各位置机械锁定。标准 PRIMA 座椅可电动升降，但无旋转及脚托。制造商为 400100 标明 100 cm 宽度；照片中的仪器及附件须在 ASEM 配置中核验。



Easyvisus One · 设备实景图

来源与文档

索取报价　查看产品

生成日期：2026-11-09

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

1仪器工位

台面可布置1台检查仪器。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

固定高度台面

支臂可在各位置进行机械锁定。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

电动可调座椅

PRIMA座椅支持电动高度调节。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

布局 Easyvisus One 工作站

制造商视图展示工作站的具体配置及仪器取用方式。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30


定位台面

文档所述台面移动便于在 Easyvisus One 上切换设备。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

规划布局

官方图纸注明占地尺寸，帮助准备 Easyvisus One 的安装。

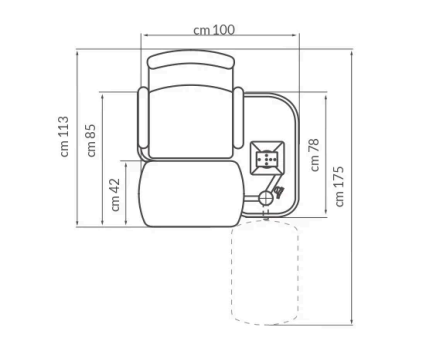

Easyvisus One · 安装布局图

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

人体工学

围绕诊疗工作站设计的布局。

仪器有序布置

设备放置于专用组合台。

工作站调节

可用移动方式便于调整配置。

实际应用能力

验光组合台

来源与文档

更流畅的工作流程

适合所选仪器的工作台

标准 400100 配单仪器固定高度工作台，未将台面描述为可电动升降。一个仪器位置不表示随组合台提供仪器。左手型 400100S 为选配版本，须单独注明。

来源与文档

已记录的控制与定位

台面支臂在各位置均为机械锁定，而非电磁锁定。标准座椅可电动升降，无旋转。360° 旋转及脚托属于 PRIMA 可选版本，不归入标准座椅。座椅升降脚踏也列于附件。

来源与文档

专为日常诊疗设计

标准座椅及可选附件

标准 PRIMA 可电动升降，采用黑色仿皮包覆，无旋转及脚托。旋转、可翻起脚托及更换其他座椅型号均为选项，并非标配特征。原始照片可能显示脚托、验光头支臂或其他选配附件，可见不表示包含。所示仪器和附件须分别列明。

来源与文档

照明及仪器供电

资料记录了仪器用 230 V 电源，但这并非整台组合台的输入电压或功耗。铝制立柱有 LED 阅读灯及视力投影仪支撑板。不类比其他 Easyvisus 增加环境 LED 或 LCD 控制。诊所连接需求须与 ASEM 核验。

来源与文档



Easyvisus One · 设备实景图

来源与文档



Easyvisus One · 设备实景图

来源与文档

安装与配置选择

100 cm 宽度明确适用于 400100。图中其他尺寸对应布局和不同位置，不转化为整体高度、单一深度或调节范围。此处未提供重量及电源频率。通行空间、左右手方向及附件须按实际安装确认。

来源与文档

技术规格与文档

品牌
F.I.S.O.

型号
Easyvisus One

技术
验光组合台

临床用途
专用技术

仪器容量
1

来源与文档

座椅高度
电动调节；标配 Prima 座椅

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

工作台高度
固定高度

来源与文档


工作台锁定
综合验光仪支臂：机械锁定

来源与文档

工作站照明
LED 阅读灯

来源与文档

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。



Easyvisus One • 安装布局图

来源与文档

下载与资源

制造商资料

PDF • 15,672 kB

来源与文档

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  来源核验日期：2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  来源核验日期：2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-one_453/
  来源核验日期：2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-18

关于 Easyvisus One 的常见问题

Easyvisus One 已记录的“仪器容量”规格是什么?

1

来源与文档

Easyvisus One 已记录的“座椅高度”规格是什么?

电动调节；标配 Prima 座椅 — 脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

Easyvisus One 的哪些配置需要确认?

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

在哪里可以找到 Easyvisus One 的文档?

制造商资料 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

来源与文档

台面可容纳几台仪器?

Easyvisus One 400100文档定义为单仪器型，采用固定高度台面和机械式台臂锁定。它不是双工位单元。

来源与文档

标准PRIMA座椅可旋转吗?

标准配置描述的是不可旋转、无脚踏且可电动升降的PRIMA座椅。PRIMA 360°旋转列为选配。

来源与文档

仪器电源有哪些规定?

手册规定仪器供电为230 V。这既不是功耗额定值，也不代表兼容所有设备。

来源与文档

相关产品



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

验光工作台

Panvisus Rondo 双仪器检查台，具体配置须确认。

查看产品



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

验光工作台

可配置2台检查仪器的综合验光台。

查看产品



Easyvisus MS33 — 2台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置2台检查仪器的综合验光台。

查看产品



Easyvisus MS33 — 3台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置3台检查仪器的综合验光台。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

专科技术

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：6b2213b72c2c