验光工作台

Easyvisus Two

可配置2台检查仪器的综合验光台。

Easyvisus Two 是双仪器 V 形固定高度验光组合台。专用机构使仪器居中，台面支臂采用机械锁定。电动升降 PRIMA、LED 阅读灯及可收回防尘抽屉属于已记录标配。固定台面不应描述为可电动垂直移动。



Easyvisus Two · 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-09

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

2仪器工位

台面可布置2台检查仪器。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

仪器居中

V形台面配备仪器居中机构。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

电动可调座椅

PRIMA座椅支持电动高度调节。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17


整合两台仪器

Easyvisus Two 官方配置将两台仪器集中于紧凑工作站。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

准备空间

尺寸图便于预先规划安装位置及台面移动。

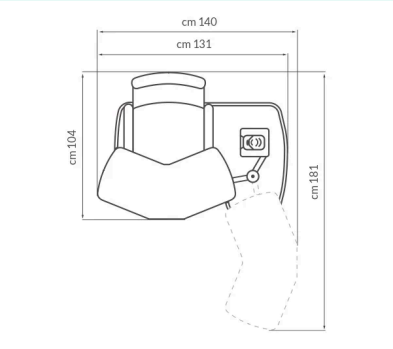


Easyvisus Two · 安装布局图

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

选择饰面

制造商色板展示可用饰面，便于工作站融入诊所环境。

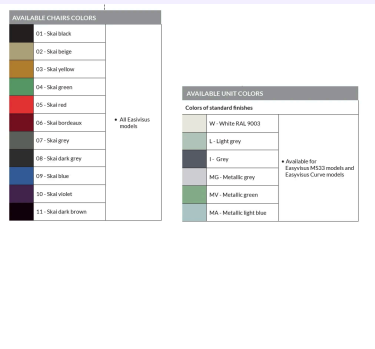

Easyvisus Two · 制造商色卡

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

人体工学

围绕诊疗工作站设计的布局。

仪器有序布置

设备放置于专用组合台。

工作站调节

可用移动方式便于调整配置。

实际应用能力

验光组合台

来源与文档

更流畅的工作流程

适合所选仪器的工作台

标准 400102 配双仪器 V 形固定高度台面及专用居中机构。制造商此处未描述可电动垂直调节的旋转台或滑动台。可收回防尘抽屉用于检眼镜及检影镜，不假定包含这些仪器。左手版 400102S 为选配。

来源与文档

已记录的控制与定位

台面支臂在各位置机械锁定，不同于 Curve、RM64 及 MS33 的电磁锁定。电动升降属于标准 PRIMA 座椅，而非 V 形台面。仪器居中应适合 ASEM 报价所选设备。座椅脚控属于可选附件。

来源与文档

专为日常诊疗设计

标准座椅及可选附件

标准 PRIMA 可电动调节高度，采用黑色仿皮包覆，不含脚托。可翻起脚托、其他包覆材料及更换其他座椅型号属于已记录选项。座椅版本须在 ASEM 报价中确认。原始照片可能展示脚托、验光头支臂或其他选配附件；可见并不证明包含在内。设备和附件须分别列明。

来源与文档

照明及仪器供电

文档记录了仪器供电变压器。铝制立柱配有 LED 阅读灯及视力投影仪支撑板。资料此处未提供整台组合台输入电压及频率，因此不将 One 仪器的 230 V 数值复制给 Two。供电设备及其要求须与 ASEM 确认。

来源与文档



Easyvisus Two · 设备实景图

来源与文档

安装与配置选择

图纸专用于 400102，展示不同布局尺寸。不将它们合并为整体尺寸、可调高度或电动行程。这些页面未记录重量。须为诊所明确左右手配置、间距、座椅及附件。照片中可见的验光头支臂或脚托不默认包含。

来源与文档

技术规格与文档

品牌
F.I.S.O.

型号
Easyvisus Two

技术
验光组合台

临床用途
专用技术

仪器容量
2

来源与文档

座椅高度
电动调节；标配 Prima 座椅

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

工作台高度
固定高度

来源与文档

工作台锁定
综合验光仪支臂：机械锁定

来源与文档


工作台移动
V 形台面；对中机构

来源与文档

工作站照明
LED 阅读灯


来源与文档

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。



Easyvisus Two · 安装布局图

来源与文档

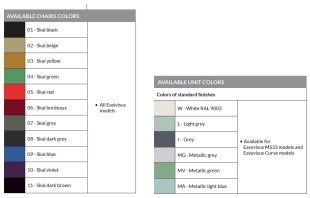

Easyvisus Two · 制造商色卡

来源与文档

下载与资源

制造商资料

PDF · 15,672 kB

来源与文档

- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  来源核验日期：2026-10-05
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-06
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  来源核验日期：2026-10-17
- https://www.fiso.info/en/products/refraction_units/easyvisus-two_454/
  来源核验日期：2026-08-30
- https://www.fiso.info/dynatc/brochure-0497-2d40/frastema_cat-fiso_16luglio_2025_med.pdf
  来源核验日期：2026-10-18

关于 Easyvisus Two 的常见问题

Easyvisus Two 已记录的“仪器容量”规格是什么？

2

来源与文档

Easyvisus Two 已记录的“座椅高度”规格是什么?

电动调节；标配 Prima 座椅 — 脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

Easyvisus Two 的哪些配置需要确认?

脚踏支撑及其他座椅为选配，不能默认已安装。

来源与文档

在哪里可以找到 Easyvisus Two 的文档?

制造商资料 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/fiso-20261006/fiso-original-2025.pdf

来源与文档

文档列明了怎样的台面形状与高度?

Easyvisus Two 400102采用固定高度V形台面，供两台仪器使用，并配有仪器对中机构。

来源与文档

文档列明了哪种锁定机构?

手册规定台臂在所有位置均采用机械锁定。不将其他单元的电磁锁定归于此型号。

来源与文档

有左手布局可选吗?

手册列明左手型400102S为选配。选择配置时须明确座椅和附件。

来源与文档

相关产品



Panvisus Rondo

F.I.S.O.

验光工作台

Panvisus Rondo 双仪器检查台，具体配置须确认。

查看产品



Easyvisus Curve

F.I.S.O.

验光工作台

可配置2台检查仪器的综合验光台。

查看产品



Easyvisus MS33 — 2台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置2台检查仪器的综合验光台。

查看产品



Easyvisus MS33 — 3台设备

F.I.S.O.

验光工作台

可配置3台检查仪器的综合验光台。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

专科技术

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：519fea43127f