影像与观察模块

Imaging Module 910

用于兼容裂隙灯的成像模块，具体配置需与ASEM确认。

Imaging Module 910 是 Haag-Streit 的成像模块，用于在兼容 BQ 900 裂隙灯上记录检查，并非独立裂隙灯。相机模块、采集控制器及 Connector Box 组成采集系统，可按配置独立使用或结合 EyeSuite Imaging。屏幕、裂隙灯、许可证及可能的 3D 立体配置须在 ASEM 报价中注明，任何选项均不自动归入标准模块。



Imaging Module 910 • 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-09

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

辅助图像采集

自动曝光与光圈控制辅助图像采集。

需使用兼容裂隙灯

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

便捷相机控制

相机与照明控制设于操纵杆旁。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

两种集成模式

支持独立运行或集成于EyeSuite。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

采集真实图像

模块通过专用成像系统记录裂隙灯观察结果。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

适时采集

采集模式使采集控制始终融入检查流程。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

复查与比较

复查模式组织图像，便于快速找到已记录的观察结果。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

针对性功能

针对具体临床需求设计的解决方案。

集成

系统补充现有设备流程。


记录

相关结果归入检查记录。

实际应用能力

记录BQ 900观察视野

该模块共享BQ 900光路，生成检查照片及视频。它是影像附件，并非独立裂隙灯。

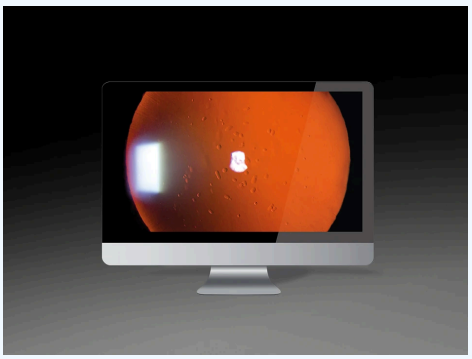

Imaging Module 910 • 制造商采集示例

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档

辅助曝光与图像选择

自动曝光、光圈控制及图像选择辅助采集。临床医生仍须评估图像质量。

来源与文档

更流畅的工作流程

无需更换裂隙灯即可记录检查

模块集成于兼容 BQ 900，并将显微镜视图共享至成像系统显示器。说明书标明 CM04 相机模块、RM03 控制器及 CB01 盒。兼容 LED 照明是安装时须核验的前提条件。制造商照片展示模块在光学环境中的状态；可见的裂隙灯部件不意味着随附件提供整台裂隙灯。

来源与文档

Connector Box 与图像管理

CB01 存储：256 GB CB01 接口：HDMI / DisplayPort / LAN EyeSuite 最低网络要求：1000BASE-T（1 Gbit/s） 独立采集模式显示观察区域及最后一幅图像。复查模式按时间顺序组织图像。EyeSuite Imaging 集成、患者记录连接及 3D 配置取决于所选系统及许可证。系列信息不表示所有功能均已激活或在所有国家可用。

来源与文档


无需离开操纵杆即可采集

RM03将采集与照明控制集中在操纵杆前方。光路选择器可将100%的光返回目镜。

来源与文档

从采集转入复核

采集模式显示观察区域和最新图像。复核模式按时间顺序浏览本次检查图像。

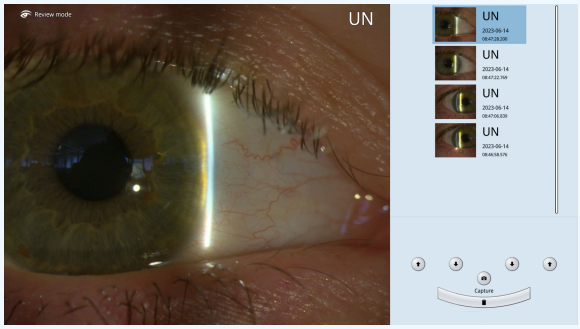

Imaging Module 910 · 制造商采集示例

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档

专为日常诊疗设计

选择独立使用或EyeSuite

CB01无需EyeSuite即可在显示器上显示视频流。EyeSuite Imaging与3D处理为分别选配激活的功能。

无3D许可时仅进行2D处理；须确认所提供许可。

来源与文档

相机与采集：已记录数据

相机接口：CoaXPress CXP 帧率：30 帧/秒 照片格式：JPG 视频格式：MP4 独立模式下，说明书允许使用 FHD 1920 × 1080、QHD 2560 × 1440 及 UHD 3840 × 2160 显示器。4K 显示限于 30 帧/秒。这些分辨率说明兼容显示规格，并不承诺随附显示器。单目光路使用右侧光束；独立的立体配置使用左右光路。

来源与文档

安装：模块尺寸，并非裂隙灯尺寸

CM04 相机尺寸（长 × 宽 × 高）：173 × 127 × 82 mm 市电电源：100–240 V AC 频率：50–60 Hz 说明书中的 4,5 kg 为含包装 IM 910 套装重量，并非模块或裂隙灯净重。包装尺寸 380 × 270 × 130 mm 不代表安装后的光学占用空间。相机电源为 24 V DC / 420 mA；CB01 使用独立电源。安装与兼容性须由受训人员结合 ASEM 验证。

来源与文档

确认兼容系统

说明书描述适用于配备相应LED照明的BQ 900的CM04、RM03及CB01。不默认其他裂隙灯或代际模块可互换。

来源与文档

技术规格与文档

品牌
Haag-Streit

型号
Imaging Module 910

技术
专用临床系统

临床用途
成像与 OCT · 诊断与生物测量

下载与资源

制造商资料

PDF · 2,975 kB

来源与文档

- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  来源核验日期：2026-10-06
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  来源核验日期：2026-10-06
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  来源核验日期：2026-10-17
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  来源核验日期：2026-08-30
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/15

00_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
来源核验日期：2026-10-18

- https://haag-streit.com/en/products/categories/general-diagnostics/slit-lamp-imaging/imaging-module-910_
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/General%20diagnostics/Slit%20lamp%20imaging/IM%20910/Instructions%20for%20use/English/1500_7221019_04020_IFU_IM_910_01_en_web.pdf
  来源核验日期：2026-10-18

关于 Imaging Module 910 的常见问题

在哪里可以找到 Imaging Module 910 的文档?

制造商资料 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/haag-streit-remaining-20261006/im910-ifu-original.pdf

来源与文档

IM910适用于哪款裂隙灯?

说明书规定其专为配备所需LED照明的BQ 900设计。

来源与文档

无许可时会启用3D处理吗?

不会。说明书规定无许可时进行2D处理，激活相应选配项后可进行立体3D处理。

来源与文档

无需EyeSuite也能显示影像吗?

可以。Connector BoxCB01无需EyeSuite即可在连接的显示器上显示实时视频流。

来源与文档

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

眼科影像与OCT

诊断与生物测量

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问

浏览全部产品

制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：6a39edaf1034