视野检查

Octopus 900

支持静态视野检查，其他功能依配置而定。

Octopus 900 是 Haag-Streit 的圆顶式视野计，用于中央及周边视野检查。平台按已激活功能提供静态视野及动态检查。EyeSuite 管理结果、既往检查及进展分析。Basic 与 Pro 版本的随附软件包及许可证不同；须确认 ASEM 配置中的 TOP、专用方法、Goldmann 动态视野及接口，不能假设包含整个系列的全部能力。



Octopus 900 • 设备实景图

来源与文档

索取报价 查看产品

生成日期：2026-11-09

> 本资料由 ASEM 编制，不能替代制造商的官方文档或使用说明。

核心优势

全视野静态检查

静态测试程序覆盖中央及周边视野。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

动态视野检查

动态检查依版本及许可而定。

选项依版本而定

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17


整体进展分析

对连续视野检查进行整体进展分析。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-10-17

评估整个视野

已记录程序在同一系统中覆盖中央及周边视野检查。

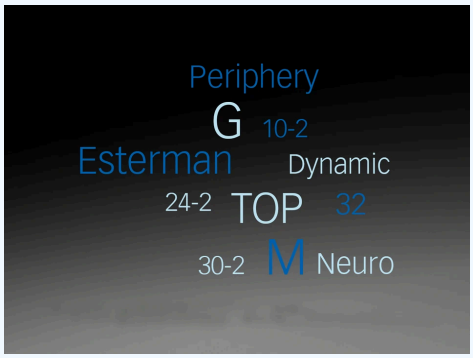

Octopus 900 · 制造商示意图

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

标准化分析

EyeSuite 汇总视野检查所需指标及显示方式。

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

跟踪变化

进展视图便于纵向比较功能检查结果。



Octopus 900 · 制造商使用场景

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档 · 来源核验日期：2026-08-30

视野

专用于功能评估的程序。

引导式流程

界面组织检查步骤。

随访分析

结果支持纵向比较。

实际应用能力

静态视野检查

动态视野 / TOP / SWAP 取决于 Basic / Pro 及选配，不能默认已包含。

来源与文档

检查中央及周边视野

周边视野：180° 圆顶半径：30 cm Goldmann 光标尺寸：I / II / III / IV / V 动态范围：47 dB 刺激投射于圆顶内。已记录程序包括中央 24-2 和 10-2、G 和 M 程序，以及周边检查。专业人员按临床问题选择程序；不能因设备具有某项检查便推断其可作法规规定的驾驶适任评估或自动诊断结论。

来源与文档


方法与策略：核对 Basic 或 Pro

Basic 和 Pro 均记录了标准白/白视野检查。表格区分了 Basic 的 TOP、Goldmann 动态视野、蓝/黄及部分专用检查选配包。参考策略时间为 TOP 2–4 分钟、Dynamic 6–8 分钟、Normal 10–12 分钟，并不保证单次检查时长。报价须注明实际激活的动态功能及选项。

来源与文档

从中心到周边

Goldmann半球形视野仪支持中心及周边检查。手册描述完整180°视野，以及G、M和双眼Esterman等程序。

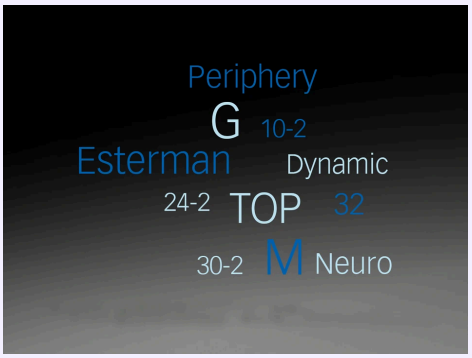

Octopus 900 · 制造商示意图

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档

绘制动态等视线

Goldmann动态视野检查支持矢量、等视线及检查模板。可用性取决于安装版本与选项。

当前制造商表格列为Basic选配、Pro标配。

来源与文档

更流畅的工作流程

注视监控及结果解读

系列文档介绍了 Blink Control、Pupil Position Control 及 AET 自动眼球跟踪。EyeSuite 汇总总体分析及进展视图；Cluster / Polar Trend 分析取决于配置的软件包。注视监控及指标辅助专业解读，不能代替对每次检查可靠性的判断。

来源与文档

集成网络与患者记录

Ethernet 连接及 EyeSuite 环境用于管理检查和阅览工作站。资料提到导入旧版 Octopus 及兼容 HFA 数据。DICOM 被列为选配；EMR 接口、版本及传输须在实际安装中核验。不承诺连接所有患者记录系统。

来源与文档


引导检查执行

引导式检查、多语言患者提示及注视监测组织检查过程。眨眼期间错过的刺激可再次呈现。

来源与文档

比较不同时期视野

EyeSuite整合视野、整体分析及趋势视图。Octopus或HFA风格呈现可适应诊所的复核偏好。

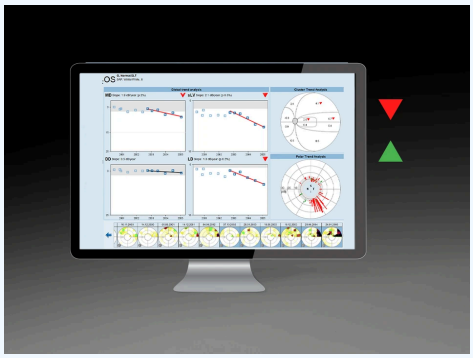

Octopus 900 · 制造商报告示例

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档

专为日常诊疗设计

监测试镜矫正

文档所列配置包含电动试镜架及距离监测。瞳孔与注视控制辅助定位。



Octopus 900 · 制造商使用场景

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

来源与文档

安装与配置

宽：648 mm 深：519 mm 高：796 mm 重量：25 kg 频率：50/60 Hz 说明书列出两种电源范围：100–120 V AC 或 220–240 V AC。标称功耗为 145 / 165 VA，视配置而定。安装布局、支架、许可证及网络设备须与 ASEM 确认。含包装的运输重量 40 kg 并非设备重量，不作为净重使用。

来源与文档

明确Basic或Pro的功能范围

SWAP、Flicker、红色刺激、动态检查及TOP并非普遍包含。报价须明确版本、检查、分析及接口。

来源与文档

技术规格与文档

品牌
Haag-Streit

型号
Octopus 900

技术
视野计

临床用途
诊断与生物测量

刺激光标尺寸
Goldmann I · Goldmann II · Goldmann III · Goldmann IV · Goldmann V

来源与文档

最大刺激强度
10000 asb


来源与文档

软件
EyeSuite

来源与文档

重量
12.7 kg

来源与文档

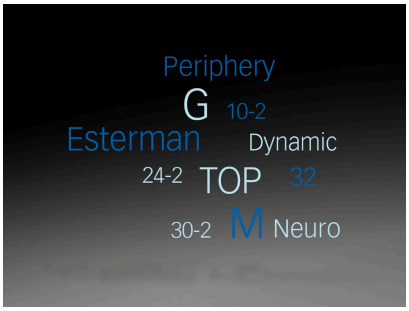

Octopus 900 · 制造商示意图

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档



Octopus 900 · 制造商使用场景

制造商示意图：图示配置可能与交付配置不同。

来源与文档

下载与资源

制造商资料

PDF · 10,177 kB

来源与文档

制造商资料

PDF · 5,010 kB

来源与文档

- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  来源核验日期：2026-10-05
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  来源核验日期：2026-10-06
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  来源核验日期：2026-10-06
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Instructions%20for%20use/English/1500_7220343_04121_IFU_OCTOPUS_900_01_en_web.pdf
  来源核验日期：2026-10-06
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  来源核验日期：2026-10-17
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  来源核验日期：2026-08-30
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_722

0444_english.pdf
来源核验日期：2026-10-18

- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/2%20Products/Speciality%20diagnostics/Perimetry/Octopus%20900/Brochures/English/HS_Oktopus_900_br_7220444_english.pdf
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  来源核验日期：2026-10-18
- https://haag-streit.com/en/products/categories/specialty-diagnostics/perimetry/octopus-900
  来源核验日期：2026-10-18

关于 Octopus 900 的常见问题

Octopus 900 已记录的“刺激光标尺寸”规格是什么?

Goldmann I · Goldmann II · Goldmann III · Goldmann IV · Goldmann V

来源与文档

Octopus 900 已记录的“最大刺激强度”规格是什么?

10000 asb

来源与文档

在哪里可以找到 Octopus 900 的文档?

制造商资料 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/haag-streit-remaining-20261006/octopus900-original.pdf 制造商资料 (PDF) — https://asem-medical.com/storage/catalogue-enrichment/haag-streit-remaining-20261006/octopus900-ifu-original.pdf

来源与文档

Goldmann动态视野检查始终包含吗?

不是。当前表格区分Basic选配与Pro标配。

来源与文档

结果可采用HFA风格呈现吗?

可以。EyeSuite为文档所述视野及报告提供Octopus和HFA风格视图。

来源与文档

文档是否列明双眼Esterman检查?

是的。它属于所列双眼视野评估程序。

来源与文档

相关产品



Octopus 600

Haag-Streit

视野检查

结合SAP静态视野与Pulsar视野检查的视野计。

查看产品



HVF-100

Huvitz

视野检查

通过白对白静态视野检查评估视野。

查看产品

探索 ASEM 目录中的临床领域

浏览 ASEM 目录中的相关领域。这些链接并不扩大本设备的适应证范围。

诊断与生物测量

不止于设备，更有长期支持

与 ASEM 沟通您的项目：设备选型、安装、培训及技术支持。



服务示意图

安装

请与我们的技术团队沟通安装条件和配置。

了解更多



服务示意图

培训

请咨询适用于您设备的培训和操作指导。

了解更多



服务示意图

售后服务

请联系 ASEM，了解适合您设备的技术协助与支持。

了解更多



服务示意图

专业咨询

请说明您的临床需求，以便共同讨论适合的设备选型。

了解更多

联系专业顾问　浏览全部产品　制造商网站

+21320092281 • direction@asem-medical.com

文档版本：6857b5b68228